
Avedro, Inc. KXL® Sistemi

Operatör Kılavuzu



Telif Hakkı 2023. Avedro, bir Glaukos Şirketi. Tüm Hakları Saklıdır.
ABD’de Basıldı

Patentler, Ticari Markalar, Telif Hakları

KXL® Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında yayınlanmış veya beklemede olan en az bir patent başvurusu kapsamında olabilir.

"KXL®" ve Avedro logo tasarımı, Avedro, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Tüm yazılım ve dokümantasyon, Avedro, Inc. şirketinin telif haklarına tabidir. Avedro, GLAUKOS Corporation'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştur. Tüm hakları saklıdır 2022.

Microsoft ve Windows, sırasıyla Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markaları ve ticari markalarıdır. Bu kılavuzda yer alan diğer ticari markalar veya hizmet markaları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Daha fazla bilgi için, irtibat kurun:

Yerel Avedro yetkili
distribütörünüz



Avedro, bir Glaukos Şirketi

30 North Ave

Burlington, MA 01803 ABD

EC REP

EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60

6827 AT, Arnhem

Hollanda

Telefon: +31 70 345 8570

CE 2797

İçindekiler

Önsöz	1
1.1 İstenen Kullanım Kılavuzu	1
1.2 İstenen Kullanım / Kullanım Endikasyonları	1
1.3 Tasarım Değişiklik Feragatnamesi	1
1.4 Yeniden Üretim Feragatnamesi	1
1.5 Kullanıcı Çalıştırma Asistanı Beyanı	2
1.6 Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve İkazlar	2
1.6.1 Kontrendikasyonlar	2
1.6.2 Uyarılar	2
1.6.3 Elektrik Güvenlik Uyarıları	2
1.7 Radyasyon Güvenlik Uyarıları	5
1.8 Hasta Güvenliği	5
1.9 İlave Güvenlik Hususları	5
1.10 FCC Uyumluluk Bildirimi	6
2 Giriş	7
2.1 Sisteme Genel Bakış	7
2.1.1 Önemli Bileşenler.....	8
3 Sistem Çalışması	11
3.1 Dokunmatik Tablet/Klavye Kullanımı	11
3.2 UV Enerji (Doz)	13
3.3 Sistemin Hazırlanması	13
3.4 Sistemi Açık Duruma Getirmeden Önce Önemli Adımlar	14
3.5 Sistemin Çalıştırılması	14
3.6 Mevcut Hasta Verileri	15
3.7 Yeni Hasta Ekle	16
3.8 Yeni Tedavi Planı Oluştur	17
3.8.1 Tedavi Edilecek Göz Seçin	17
3.8.2 KXL Varsayılan Tedavi Türünün Seçilmesi	18
3.8.3 Özel Tedavi Planları	18
3.8.4 Özel Tedavi Parametrelerinin Değiştirilmesi	19
3.9 Tedavinin Başlatılması.....	20
3.9.1 Tedavi / RFID Aktivasyon Kartı Takın	20
3.9.2 Tek Kullanımlık Aktivasyon Kartları	21
3.9.3 Çok kullanımlı Aktivasyon Kartları	22
3.9.4 RFID Kart ile kontrol edilen Sınırlar	23
3.9.5 Uzaktan Kumanda Hizalamasını Senkronize Et.....	24
3.10 Hastanın Hazırlanması.....	26
3.10.1 Riboflavin, İndüksiyon ve Hizalamanın Uygulanması	27
3.11 Tedavinin Başlatılması.....	29
3.12 Tedavinin İzlenmesi.....	30
3.13 Tedavinin Duraklatılması.....	31
3.14 Tedavi Ortasında İptal	31
3.15 Görüntülerin Yakalanması.....	33
3.16 Tedavi Tamamlandı	34
3.17 Görüntülerin İncelenmesi	34

3.18	Fotoğrafların Silinmesi	34
3.19	Hasta Tedavi Raporu	36
3.19.1	Bir Hasta Tedavi Raporuna Not Eklenmesi	37
3.19.2	Tedavi Raporunun Dışarı Aktarılması	38
3.19.3	Tedavi Raporunun Görüntülenmesi	40
3.20	KXL Sisteminin Kapatılması	44
3.21	Seçenekler Menüsüne Erişilmesi.....	45
3.21.1	Klinik Önceden Ayarlanmış Planları Yönet	45
3.21.2	Sistem Ayarları Menüsü.....	46
3.21.3	Sistem Ayarları – Sistem Ses Düzeyinin Değiştirilmesi	47
3.21.4	Sistem Ayarları – Kamera Beyaz Dengesinin Değiştirilmesi	47
3.21.5	Sistem Ayarları – Hizalama Artı İmleçleri Yoğunluğunun Değiştirilmesi	48
3.21.6	Sistem Ayarları – Farklı bir Sistem Dilinin Seçilmesi	48
3.21.7	Sistem Ayarları – Hizmet Günlüğünü Dışarı Aktar	49
3.21.8	Sistem Ayarları – Hasta Verilerinin Yedeklenmesi ve Saklanması	50
3.21.9	Sistem Ayarları – Klinik Önceden Ayarlanmış Ekran Önceliği.....	50
3.21.10	Servis Ayarları.....	50
3.21.11	Demo Modu	50
4	Bakım / Hizmet.....	53
4.1	Kurulum Politikası	53
4.2	Müşteri Bakımı	53
4.3	Garanti Bilgileri.....	53
4.4	Servis Sözleşme Bilgileri	53
4.5	Her bir Hasta için Tek Kullanımlık Malzemeler	53
4.6	Sorun Giderme	54
4.6.1	Kablosuz Uzaktan Kumanda	54
4.7	Dezenfeksiyon Yönlendirmeleri	57
4.8	Sistemin Temizlenmesi.....	57
4.9	Açıklığın Temizlenmesi	58
4.10	Eklemli Kol Ayarlaması	58
4.11	Sistemi Taşınması.....	60
4.12	Sistemin Saklanması.....	61
4.13	Yazılım	61
4.14	Atık Ürünlerin İmhası ile İlişkili Riskler	62
4.15	Görünür Bir Kontrol Gerçekleştirilmesi.....	62
5	Ekipman Sınıflandırması	63
6	Sembol Kütüphanesi.....	70
7	Teknik Özellikler	72

Şekiller Tablosu

Şekil 2-1. Sistem Görseline Genel Bakış.....	8
Şekil 2-2. Bilgi İçeren Sistem Görselleri	9
Şekil 2-3. Kablosuz Uzaktan Kumanda	9
Şekil 2-4. KXL Etiketleri	10
Şekil 2-5. UV yayıcı Etiketleri.....	10
Şekil 2-6. Lazer Sınıflandırma Etiketleri.....	10
Şekil 3-1. Güç Anahtarı	14
Şekil 3-2. Hasta Veritabanı.....	15
Şekil 3-3. Hasta Bilgilerini Gir.....	16
Şekil 3-4. Yeni Tedavi Planı Oluştur	17
Şekil 3-5. Göz Seç	17
Şekil 3-6. Varsayılan bir Tedavi Planı Gerçekleştir	18
Şekil 3-7. Klinik Önceden Ayarlanmış Tedavi Planı Kaydet	19
Şekil 3-8. Özel Tedavi Planı – Sürekli UV Modu	20
Şekil 3-9. KXL Aktivasyon Kartını Takın	21
Şekil 3-10. Aktivasyon Kartının Okunması	21
Şekil 3-11. Kart Tedavi Bakiyesi	22
Şekil 3-12. Kart Bakiyesi: Kalan Tedaviler	22
Şekil 3-13. Tedavi Kalmadı.....	23
Şekil 3-14. Geçersiz Tedavi Parametreleri	23
Şekil 3-15. Geçersiz Tedavi Parametreleri	24
Şekil 3-16. Uzaktan Kumanda Senkronize Et	24
Şekil 3-17. Sistem Kurulum Durumu.....	25
Şekil 3-18. Senkronizasyon İşlemi Zaman Aşımına Uğradı.....	25
Şekil 3-19. Uzaktan Kumanda Gösterge Işığı Durumu ve Anlamı	26
Şekil 3-20. Uzaktan Kumanda Gösterge Işığı Durumu ve Anlamı	26
Şekil 3-21. Tedavi için Hazırlan: Riboflavin uygula.....	27
Şekil 3-22. İndüksiyon Sırasında Artı İmleçlerini Hizala	28
Şekil 3-23. Kırmızı İmleçlerin Hizalanması – X ve Y Eksenleri ve Z Eksenini	28
Şekil 3-24. Uzaktan İşlevler.....	29
Şekil 3-25. UV Tedavisini Başlat.....	29
Şekil 3-26. Tedavi Devam Ediyor Ekranı.....	30
Şekil 3-27. Tedavi Duraklatıldı Ekranı	31
Şekil 3-28. Kısmi Tedaviyi İptal Et Seçeneğini Onayla	32
Şekil 3-29. Tedavi İptal Edildi Onaylama.....	32
Şekil 3-30. Kısmi Tedavi Tamamlanmadı	33
Şekil 3-31. Görüntülerin Yakalanması.....	33
Şekil 3-32. Tedavi Tamamlandı Ekranı	34
Şekil 3-33. Silmek için Çöp Kutusu seçimi yapın	35
Şekil 3-34. Silmek için Evet seçimi yapın.....	35
Şekil 3-35. Seçim Yapıldı	36
Şekil 3-36. Örnek Tedavi Raporu	37
Şekil 3-37. Yorumlar Simgesi	37
Şekil 3-38. Yorumlar Bölümü	38
Şekil 3-39. Tedavi Raporunun Dışarı Aktarılması	38
Şekil 3-40. USB Tak	39
Şekil 3-41. USB Hatası ve USB’de Boş Alan Yok	39
Şekil 3-42. Tedavi raporunun oluşturulması.....	39

Şekil 3-43. Tedavi raporu dışarı aktarıldı	40
Şekil 3-44. Sayfa 1 / 3: Tedavi Ayrıntıları	41
Şekil 3-45. Sayfa 2 / 3: Yorumlar.....	42
Şekil 3-46. Sayfa 3/3: Fotoğraflar	43
Şekil 3-47. “Kapat” (Power Off) Seçimi Yap	44
Şekil 3-48. “Kapat” (Power Off) Seçimini Onayla.....	44
Şekil 3-49. Pozisyonu Kapat.....	45
Şekil 3-50. “Seçenekler” (Options) düğmesine basın	45
Şekil 3-51. Klinik önceden ayarlanmış planlarını yönet	46
Şekil 3-52. Sistem Ayarları Menüsü	46
Şekil 3-53. Ses Yüksekliğini Düzenle	47
Şekil 3-54. Kamera Beyaz Dengesini Düzenle	47
Şekil 3-55. Hizalama Artı İmleçleri Yoğunluğu	48
Şekil 3-56. Sistem Dilini Düzenle.....	48
Şekil 3-57. Hizmete Günlüğünü USB’ye Dışarı Aktar	49
Şekil 3-58. Hizmet Günlüğü Dışarı Aktarılıyor	49
Şekil 3-59. Klinik Önceden Ayarlanmış Ekran Önceliği.....	50
Şekil 3-60. Hasta Listesi Demo Modu Gösterir	51
Şekil 3-61. Demo Modu, Ekranın Üstünde gösterilir	52
Şekil 4-1. Pil Bölmesine Eriş	54
Şekil 4-2. Hizalama Uzaktan Senkronizasyon Kaybı – Orijinal Uzaktan Kumanda	55
Şekil 4-3. Hizalama Uzaktan Senkronizasyon Kaybı – Güncellenmiş Uzaktan Kumanda	56
Şekil 4-4. Kolu Zemine Paralel olarak Konumlandırın	58
Şekil 4-5. Denge Ayar Vidası A’yı Gevşetin	59
Şekil 4-6. Denge Ayar Vidası B’yı Gevşetin	59
Şekil 4-7. Güç Ayarlama Vidası C ile Kol Gerginliğini ayarlayın	60
Şekil 4-8. Sistem Yapılandırmasının Taşınması	61

Önsöz

1.1 İstenen Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz, Avedro, Inc. şirketi KXL Sisteminin operatörlerine hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Tüm çalıştırma talimatı, ürün görselleri, ekran grafikleri, sorun giderme/hata mesajları ve diğer ilgili bilgiler, bu kılavuzda yer almaktadır. Bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatının sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlamak operatörün sorumluluğundadır.

1.2 İstenen Kullanım / Kullanım Endikasyonları

KXL Sistemi, hastalık veya refraktif cerrahi ile zayıflatılmış korneayı stabilize eden korneal çapraz bağlama prosedürleri sırasında korneayı aydınlatmak üzere amaçlanan kullanım için hedeflenen tedavi alanına tek tip, doz ayarlı bir UVA ışığı dozu verir.

1.3 Tasarım Değişiklik Feragatnamesi

- Tasarım değişiklikleri ve ürün iyileştirmeleri nedeniyle, bu kılavuzdaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Kılavuzun en güncel versiyonu Glaukos.com web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca Avedro/Glaukos, güvenlik ve kılavuzlardaki uyarılarla ilgili tüm güncellemeleri distribütörlere ve müşterilere bildirecektir.
- Bu kılavuzda tasvir edilen bilgisayar görüntüleme ekranları sadece temsilidir. Sistemin yazılım sürümüne bağlı olarak, gerçek bilgisayar ekranları ile bu kılavuzda gösterilenler arasında küçük farklılıklar olabilir.
- Örnek ekran grafikleri de dahil olmak üzere bu belgede görünen tüm hasta verileri hayal ürünüdür ve sadece temsilidir. İzinli veya izinsiz hiçbir hastanın gizliliği ihlal edilmemiştir.

1.4 Yeniden Üretim Feragatnamesi

Avedro, Inc. şirketinin önceden yazılı izni olmadan bu kılavuz veya herhangi bir bölümü hiçbir şekilde çoğaltılamaz, fotokopisi çekilemez veya elektronik ortamda aktarılamaz.

1.5 Kullanıcı Çalıştırma Asistanı Beyanı

KXL Sisteminizi çalıştırmada herhangi bir zorluk yaşamanız halinde lütfen yerel Avedro yetkili temsilcinizle irtibat kurun.

1.6 Kontrendikasyonlar, Uyarılar ve İkazlar

1.6.1 Kontrendikasyonlar

Bu bölümde, kullanım riskinin herhangi bir olası faydadan açıkça daha ağır basmasından dolayı cihazın kullanılmaması gereken durumlar açıklanmaktadır. Cihazın kullanımını engelleyebilecek koşullar arasında bulunanlar:

- Epitelyumlu <375 mikrondan az kornea kalınlığı.
- Kornea erime hastalıkları
- Afakik hastalar
- İmplant UV bloke edici lens olmadan psö dofakik hastalar
- Hamile ve bebeğini anne sütüyle besleyen kadınlar
- Çocuklar

1.6.2 Uyarılar

Doktorların aşağıdaki durumlara sahip hastalarda potansiyel faydaları değerlendirmesi gerekir:

- Herpes simplex, herpes zoster keratit, nüks kornea erozyonu, korneal distrofi
- Epitelyal tedavi hastalıkları
- Bu kılavuzda, İkazlar şu şekilde tanımlanır: kullanıcıyı, cihazın kullanımıyla veya yanlış kullanımıyla ilişkili cihazda bir sorun olasılığı konusunda uyarı bir ifade. Bu tür sorunlar arasında cihaz arızası, cihaz hatası, cihaz hasarı veya diğer mülklere verilen hasar bulunur. İkaz uyarısı, tehlikeden kaçınmak için alınması gereken önlemleri içerir.
- Bu kılavuzda Uyarı şu şekilde tanımlanır: kullanıcıyı yaralanma, ölüm veya cihazın kullanımı veya yanlış kullanımıyla ilişkili diğer ciddi advers reaksiyonlar olasılığı konusunda uyarı bir ifade.

1.6.3 Elektrik Güvenlik Uyarıları

- Bu ekipman, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile ilgili özel önlemler gerektirir. Kurulum ve kullanımın bu kılavuzda verilen EMC bilgilerine göre gerçekleştirilmesi gerekir.

- Taşınabilir ve mobil RF bağlantı ekipmanı, Avedro KXL Sistemi gibi tıbbi elektrikli ekipmanları etkileyebilir.

Ekipman Sınıflandırmaları için lütfen Bölüm 5.0 Ekipman Sınıflandırmasına bakın.



UYARI: Herhangi bir onarım veya tamirin sadece Avedro'nun eğitimli personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

UYARI: Üreticinin izni olmadan bu ekipmanı DEĞİŞTİRMEYİN.



UYARI: Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için ekipmanın mutlaka koruyucu topraklamalı şebeke elektriğine bağlanması gerekir.

Sistem bağlantısını şebekeye ayırmak için, güç kablosu fişini tutun ve bağlantıyı kesmek için prizden çekin.

Sistem, harici konektör kullanılarak sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır.



UYARI: Bu ekipman, elektrik çarpmasına, yanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeli voltajlarla çalıştırılır. Elektrik çarpması ve istemsizce UVA'ya maruz kalma olasılığını azaltmak için sabit panelleri çıkarmayın. Bu kılavuzda açıklananların ötesinde, sisteme yapılan tüm tamirin sadece nitelikli Avedro yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.



UYARI: Ekipmanı tamir etmeden veya temizlemeden (dezenfekte etmeden) önce sistemi kapatın ve duvar fişini çıkarın.

Güç kablosunu prizden çıkarmak için hiçbir zaman kablolardan çekmeyin. Güç kablosu fişini tutun ve bağlantıyı kesmek için prizden çekin.

Ekipmanın güç kablosunu prizden çıkarmanın zor olmayacağı şekilde konumlandırılması gerekir.



UYARI: Ekipmanı hasarlı bir güç kablosuyla çalıştırmayın.



UYARI: Güç kablosunu takılmayacak, üzerine basılmayacak, yuvarlanmayacak, kıvrılmayacak, bükülmeyecek, sıkışmayacak veya yanlışlıkla duvar prizinden çıkmayacak şekilde konumlandırın.



UYARI: Aleti suya yakın yerde kullanmayın ve herhangi bir kısmına sıvı dökmemeye dikkat edin.



UYARI: KXL Sistemini alev alabilen karışımların veya anestetiklerin olduğu ortamda çalıştırmayın.



UYARI: Hiçbir zaman doğrudan UV ışık demetine bakmayın. Terapötik amaçlar doğrultusunda olmadıkça ışını hiçbir zaman bir kişiye yöneltmeyin.



UYARI: Elektro-optik tıbbi cihazların kullanımına dair yerel düzenlemelerin dikkate alınmaması, elektromanyetik parazit nedeniyle arızalara neden olabilir.



UYARI: Uzaktan kumanda, değiştirilebilir piller içerir; sistemin uzun bir süre kullanılmayacak olması halinde pilleri çıkarın.



UYARI: Birlikte verilmeyen aksesuarların kullanılması, cihaz uyumsuzluğuna neden olur



UYARI: Bu ekipmanın CISPR Emisyon gereksinimlerine uygun olması durumunda bile diğer ekipmanla sistem arasında parazit olabilir.



UYARI: Yanlış çalışmaya neden olabileceğinden dolayı bu ekipmanın başka ekipmanla yan yana veya üst üste kullanımından kaçınılması gerekir. Böyle bir kullanım gerekli olması halinde normal çalıştıklarını doğrulamak için bu ekipmanın ve diğer ekipmanların gözlenmesi gerekir.



UYARI: Taşınabilir RF bağlantı ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), Avedro KXL sisteminin (110-01019) üretici tarafından belirtilen kablolar dahil herhangi bir parçasına

30 cm'den (12 inç) daha yakın yerlerde kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde bu ekipmanın performansı olumsuz etkilenebilir.



UYARI: Hasta tarafından kullanılırken sistemin tamir edilmemesi veya bakımın yapılmaması gerekir.



UYARI: MR Güvensiz - Manyetik rezonans görüntüleme ekipmanından uzak tutun.



UYARI: Hasarlı veya arızalı bir cihazı kullanmayın. Bu tür cihazların kullanılması kullanıcıya ve/veya hastaya zarar verebilir.

1.7 Radyasyon Güvenlik Uyarıları



UYARI: Pürüzsüz metal yüzeylerden yansıyan UV radyasyonunu önlemek için sadece lazer dereceli aletler kullanın.



UYARI: Bu üründen yayılan UV. Korumasız ürünlere göz ve cilt maruziyetinden kaçınınız. Terapötik amaçlar doğrultusunda olmadıkça ışını hiçbir zaman bir kişiye yöneltmeyin.

1.8 Hasta Güvenliği

- Hastanın dikkatini dağıtmamak için tedavinin sessiz ve rahat bir ortamda yapılması gerekir. Hastanın bir muayene yatağına veya hasta koltuğuna uzanması gerekir. Hastanın başının bir baş dayanağında rahatça dinlenmesi gerekir. Tedavi prosedürü sırasında muayene yatağına veya hasta koltuğunun ya da sistemin hareket ettirilmemesi zorunludur.



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KXL Sistemi tıbbi bir cihazdır. Bu yüzden, sadece sağlık hizmeti tesislerinde veya tıbbi eğitim almış personelin gözetimi altında tıbbi alanlarda çalıştırılabilir.

1.9 İlave Güvenlik Hususları

- Optik elemanlar aracılığıyla sistemin harici ışık demetinde herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

- Spekulumlar veya göz korumaları gibi plastik aletler, UV ışınından etkilendiğinde hasar görebilir ve muhtemelen ürünün bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden, sadece Avedro tarafından önerilen aksesuarların veya paslanmaz çelik cerrahi aletlerin kullanılması gerekir.
- Pürüzsüz metal yüzeyler, onları boşaltma çabasına rağmen yansıtabilir. Bu yüzden, sadece lazer dereceli aletlerin kullanılması gerekir.

1.10 FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Kısımına göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun bulunmuştur. Bu limitler, ikamet ortamında zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat kılavuzuna uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması halinde radyo bağlantılarında zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipmanın, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebileceği radyo veya televizyon reseptörüne zararlı parazitlere neden olması halinde kullanıcı, aşağıdaki tedbirlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye teşvik edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin,
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki elektrik çıkışına takın.
- Yardım için Avedro Müşteri Hizmetlerine danışın.
- FCC emisyon limitlerini karşılamak için uygun şekilde korumalı ve topraklanmış kabloların ve konektörlerin kullanılması gerekir. Uygun kablolar ve konektörler Avedro'dan temin edilebilir. Avedro, bu ekipmanda yapılan yetkisiz değişikliklerin veya modifikasyonların neden olduğu herhangi bir radyo veya televizyon parazitinden sorumlu değildir. Yetkisiz değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

2 Giriş

2.1 Sisteme Genel Bakış

KXL Sistemi, Riboflavin solüsyonu uygulandıktan sonra korneaya dairesel, geniş huzmeli bir modelde ultraviyole ışık (365 nm dalga boyu) veren elektronik bir tıbbi cihazdır. Riboflavin ışınlanması, korneal kollajen içinde moleküller arası bağlar oluşturan ve çapraz bağlanma yoluyla korneayı sertleştiren tekli oksijen yaratır. Korneadaki UV fluksu ve ışınlama süresi (yani acıclılık) yerleşik bir bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilir.

Optics Head, UVA ışınlama mekanizmasını ve kamerayı barındırır. LED, üretici tarafından 3 mW/cm² ila 45 mW/cm² arasında bir yoğunlukta 365 dalga boyunda UVA radyasyonu yayacak şekilde önceden ayarlanmıştır.

UVA irradyasyon ışın yoluna monte edilmiş sabit bir açıklık, tedavi düzleminde yaklaşık 9 mm'lik çapta tekdüze dairesel bir irradyasyon alanı üretmek için kullanılır. Hizalama lazerleri, kullanıcının ışını hastanın korneasına odaklamasına yardımcı olmak için kullanılır. Hizalama lazerlerinin gözlemlenmesiyle UV ışınının ince hizalanması, kablosuz bir uzaktan kumanda ve dahili bir sürücü sistemi ile kontrol edilir. Tedavi gücü, kullanıcı tarafından 1 mW/cm²'lik artışlarla 3 mW/cm²'den 45 mW/cm²'ye kadar seçilebilir. Toplam Enerji, kullanıcı arayüzünde 0,1 J/cm² artışlarla seçilebilir. Ancak, güç ve enerjinin gerçek sınırları, RFID tedavi kartı ile kontrol edilir.

KXL, UV ışınının hastanın korneasına hizalanması için sistemin hareketini sağlayan mafsallı bir kola sahip taşınabilir bir sistemdir. Tedavi parametreleri (Riboflavin İndüksiyon Dönemi, Toplam UV Enerjisi, UV Gücü ve UV Vurum Döngü Süreleri) kullanıcı arayüzü dokunmatik ekranlı bilgisayardan seçilir.

KXL Sistemi, bir Riboflavin solüsyonu ve bir RFID kartı ile birlikte kullanılır.

NOT: Bu kılavuzda yer alan KXL Sisteminin tasvirleri ve kullanıcı arayüzü ekran görüntüleri yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek ürün farklılık gösterebilir.


2.1.1 Önemli Bileşenler

KXL Sisteminin ana bileşenleri aşağıdakileri içerir:


- UV kaynaklı ve Kameralı Optik Başlık
- Kullanıcı arayüzlü KXL konsolu
- Kablosuz uzaktan kumanda (değiştirilebilir pillerle)
- KXL Çapraz Bağlama Tedavi Kiti (tek kullanımlık ayrı olarak sağlanır)
- Hastane Sınıfı AC güç kablosu (Kilitlenebilir/ayrılabilir)
- Sistem Parça Numarası: 110-01019



Şekil 2-1. Sistem Görseline Genel Bakış

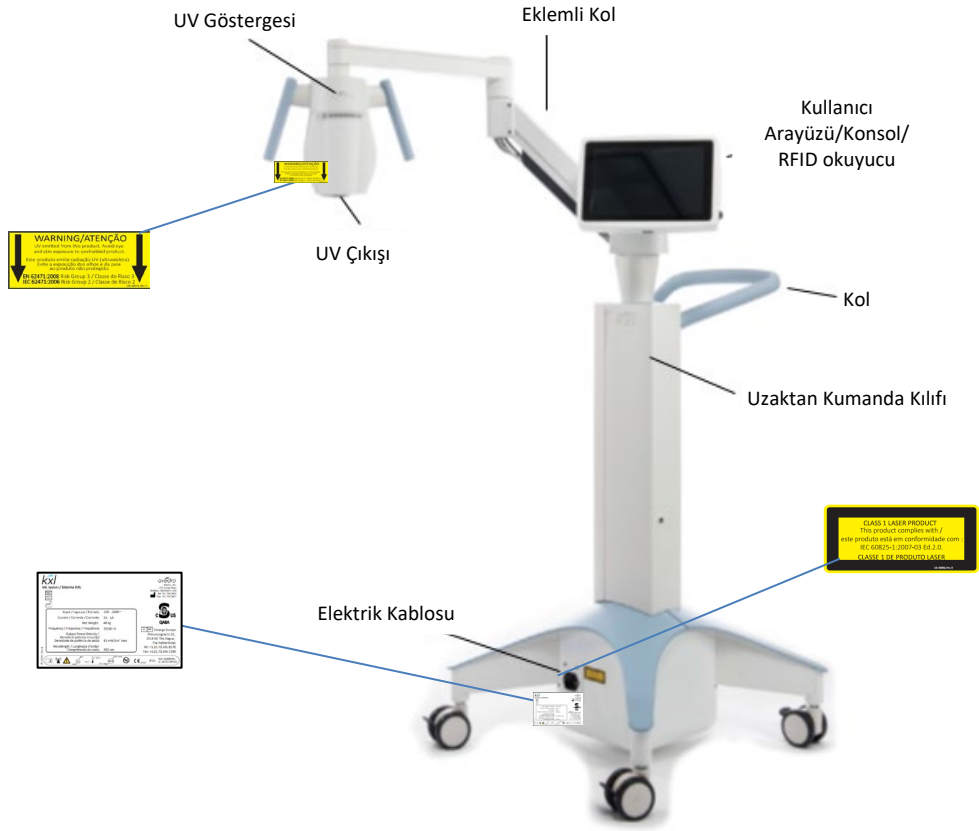

Şekil 2-2. Bilgi İçeren Sistem Görselleri

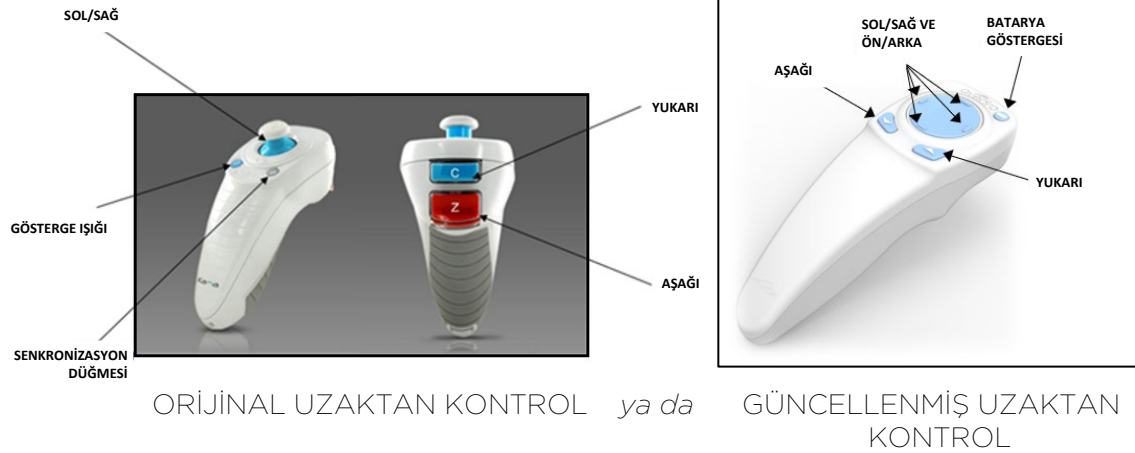

Şekil 2-3. Kablosuz Uzaktan Kumanda

kxl
KXL System / Sistema KXL

REF 110-01019
SN KXL123456
2023

GLAUKOS
Avedro, a Glaukos Company
30 North Ave.
Burlington, MA 01803 USA
Tel: 781.768.3400
Fax: 781.768.3401

CSUS
QABA

EC REP Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands
Tel: +1.31.70.345.8570

Input / Ingresso / Entrada:	100 – 240V ~
Current / Corrente / Corrente:	2A - 1A
Net Weight:	48 kg
Frequency / Frequenza / Freqüência:	50/60 Hz
Output Power Density / Densità di potenza in uscita/ Densidade de potência de saída:	45 mW/cm ² max
Wavelength / Lunghezza d'onda/ Comprimento de onda:	365 nm

IP20 FCC: SX90RFID1 IC: 5675A-ORFID1

20% 30 C 810 mbar 1050 mbar



(01)00855574003045(21)KXL123456(11)230720

LBL-000597 Rev 2

Şekil 2-4. KXL Etiket

WARNING/ATENÇÃO
UV emitted from this product. Avoid eye and skin exposure to unshielded product.
Este produto emite radiação UV (ultravioleta). Evite a exposição dos olhos e da pele ao produto não protegido.
EN 62471:2008 Risk Group 3 / Classe de Risco 3
IEC 62471:2006 Risk Group 2 / Classe de Risco 2
LBL-00419, Rev. A

Şekil 2-5. UV yayıcı Etiket











CLASS 1 LASER PRODUCT
This product complies with /
este produto está em conformidade com :
IEC 60825-1:2007-03 Ed.2.0.
CLASSE 1 DE PRODUTO LASER
LBL-00059, Rev. B











Şekil 2-6. Lazer Sınıflandırma Etiket

3 Sistem Çalışması

3.1 Dokunmatik Tablet/Klavye Kullanımı

Aşağıdaki tablo, önemli dokunmatik tablet tuşlarını ve KXL Sisteminin çalışmasına özgü simgeleri tanımlayıp açıklar. Bölüm 2, KXL Sisteminin ana bileşenlerini tanımlayıp açıklar.

Dokunmatik Tablet Tuşu	Simge	Açıklama/işlev
Güç Kapatma düğmesi (Başlangıç ekranı)		Konsola giden elektrik gücünü KAPALI duruma getirir.
Yeni hasta ekle (Add new patient) düğmesi (Başlangıç ekranı)		Hastayı tedavi etmeden önce hasta bilgilerini ekle
Seçenekler düğmesi (Başlangıç ekranı)		Sistem ayarlarını görüntüler ve önceden ayarlanmış planları yönetir
Aktivasyon kartı bakiyesi düğmesi		Tedavi kartındaki bakiyeyi görüntüler
Klinik önceden ayarlanmış planlarını yönet		Önceden ayarlanan tedavi planı parametrelerini değiştir
Sistem Ayarları		Cihaz ayarları menüsü görüntülenir
Servis ayarları		Varsayılan parametreleri düzenleyebilme
Başlamak için yeni tedavi planı oluşturun (Hastaya genel bakış ekranı)		Hasta için önceden ayarlanmış veya değiştirilmiş tedavi planını başlatır
YUKARI oku (çeşitli Klinik Protokol ekranları)		Mevcut alanın değerini artırır.
AŞAĞI oku (çeşitli Klinik Protokol ekranları)		Mevcut alanın değerini azaltır.

Dokunmatik Tablet Tuşu	Simge	Açıklama/İşlev
X düğmesi (çeşitli ekranlar)		Bir ekrandaki tüm girişleri iptal eder ve önceki ekrana geri döner.
Onay işareti düğmesi (çeşitli ekranlar)		Sistemi, mevcut ekran girişlerini kabul etmeye ve bir sonraki adıma geçmeye yönlendirir.
İptal düğmesi (çeşitli ekranlar)		Bir ekrandaki tüm girişleri iptal eder ve önceki ekrana geri döner.
Yapıldı düğmesi (çeşitli ekranlar)		Ekrandaki değişiklikleri kaydeder veya kullanıcıya bildirimler sağlar ve ardından önceki ekrana döner.
Dışarı aktarma düğmesi		Hasta tedavi raporunu USB'ye dışarı aktarır
Yorum ekle (Add comment) düğmesi (hastaya genel bakış ekranı)		Bir hasta tedavi raporuna not ekleyin.
Çöp Kutusu simgesi		Tedavi sırasında çekilen fotoğrafları silin.
Tedaviyi İptal Et (Cancel Treatment) düğmesi (çeşitli Klinik Protokol ekranları)		Bir hasta için tedavi oturumunu iptal eder.
Zamanlayıcı başlat (Start timer) düğmesi		Tedavi zamanlayıcı başlatır
Tedavi türünü değiştir (Change treatment) düğmesi		Tedavi türünü değiştirir
Tedavi gerçekleştir (Perform treatment) düğmesi (çeşitli Klinik Protokol ekranları)		Tedaviyi başlatır



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: KXL Sistemini sadece nitelikli ve deneyimli personel çalıştıracaktır.

3.2 UV Enerji (Doz)

- UV Enerjisi (Doz), UV Gücü (Yoğunluk) ve UV Işınlama Süresinin ürünüdür. UV Enerjisi ve UV Gücü ayarlanabilir ve hesaplanan UV İrradyasyon Süresi görüntülenir.
- Sistem, tedavi sırasında UV Enerjisi, UV Gücü, UV İrradyasyon Süresi ve Toplam Tedavi Süresini izler.
- Bu seçenekler, tedavi planı modu sırasında kullanıcı tarafından seçilebilir. Bkz. Bölüm 3.8.3
- Sürekli ve Darbeli olmak üzere iki UV tedavi modu vardır.

- Sürekli Mod: UV çıkışı, UV işlemi süresince sabittir.

Sürekli Mod Parametreleri:

İndüksiyon Dönemi: 1 saniye – 30 dakika
 UV Enerjisi*: 1 – 10,7 J/cm²
 UV Gücü: 3 – 45 mW/cm²

**Kullanıcı 0,1 J/cm²'lik artışlarla UV Enerjisini seçebilir. Enerji aralığı, RFID kartı ile kontrol edilir.*

- Darbeli Mod: UV çıkışı, kullanıcının seçtiği aralıklarla AÇIK ve KAPALI duruma getirir.

Darbeli Mod Parametreleri:

İndüksiyon Dönemi: 1 saniye – 30 dakika
 UV Enerjisi*: 1 – 10,7 J/cm²
 UV Gücü: 6 – 45 mW/cm²
 UV AÇIK Süre: 1,0 – 4,0 Saniye
 UV KAPALI Süre: 1,0 – 4,0 Saniye

**Kullanıcı 0,1 J/cm²'lik artışlarla UV Enerjisini seçebilir. Enerji aralığı, RFID kartı ile kontrol edilir.*

- Formülasyon bilgileri için lütfen Riboflavin Kullanım Talimatına (KT) bakın.

3.3 Sistemin Hazırlanması

- KXL Sistemini muayene yatağı veya koltuğunun yanına yerleştirin. Cihazın konumunu sabitlemek için tekerlekleri kilitleyin.
- Sistemin AÇIK durumda olduğundan emin olun.

- Sistem kullanılırken başınızı pencerelerin önüne yerleştirmek gibi parlak ışıklardan uzak tutun.
- Demet açıklığının cam penceresinde toz ve kir olup olmadığını kontrol edin. Temizleme talimatı için Bölüm 4.7 ve 4.8'e bakın.

3.4 Sistemi Açık Duruma Getirmeden Önce Önemli Adımlar

- Bir tedaviye başlamadan önce KXL Sisteminin uygun şekilde çalıştığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.
- Sistemin uygun şekilde çalıştığından emin olmak için aşağıdaki zorunlu noktaları göz önünde bulundurun:
 - Görünür hasar açısından cihazı, aksesuarları ve bağlı kabloları inceleyin.
 - Taşınabilir elektro optik tıbbi cihazların kullanıma dair yerel düzenlemeleri dikkate alın.

3.5 Sistemin Çalıştırılması

- Güç kablosu fişine bağlı olan KXL Sisteminin tabanında bulunan ana güç anahtarını AÇIK duruma getirin. Bu anahtar, AC şebeke gücünü KXL Sistemine iletir.
- KXL görüntüleme ekranının yan kısmındaki güç açma düğmesine basın ve bırakın. Bkz. Şekil 3-1. KXL Sistemi, çalıştırma sistemini ve tüm yapılandırma ve referans dosyalarını yükleyerek bir güç açma sırası başlatacaktır.



Şekil 3-1. Güç Anahtarı

- NOT: Bir Başlatma hatası olması halinde lütfen hata mesajlarını not alın ve distribütörünüz veya Müşteri Hizmetinizle irtibat kurun.
- Güç Kapatma sırası talimatı için lütfen Bölüm 3.21'e bakınız.
- Şekil 3-2'de gösterilen Hasta Listesi şunları saklar:

- o Öncesinde tedavi edilen hastalar
- o Kaydedilmiş tedavi planları olan tedavi edilmemiş hastalar
- o Atanmış tedavi planı olmayan yeni hastalar

Last	First	Patient ID	Sex	DOB	Treatment status
Allen	April	23434221	F	28 Feb, 1967	Created OS LASIK/PRK - 9 Feb
Anderson	James	65334533	M	19 Jul, 1982	Created OD Accel CXL - 10 Feb
Birmingham	Gerard	34234244	M	1 Jan, 1973	Treated OD, OS Multiple - 9 Feb
Bradford	Rachel	12323197	F	18 Oct, 1969	Treated OD OS Custom - 2 Feb
Chamford	Steven	58345999	M	13 Mar, 1984	Patient added 12 Feb
Costantino	Caroline	62445789	F	3 Mar, 1993	Created OD Preset 1 - 11 Dec

Şekil 3-2. Hasta Veritabanı

3.6 Mevcut Hasta Verileri

- Mevcut bir hasta için Hasta Listesi araması yapmak için, “hasta ara” kutusuna dokunun ve bir klavye açılacaktır. Hastaların adını yazın ve sonuçlar doldurulacaktır.

3.7 Yeni Hasta Ekle

- Yeni bir hasta eklemeyi başlatmak için, "Yeni hasta ekle" seçeneğini seçin ve bir Şekil 3-3'te gösterilen bir açılır pencere görünecektir.

The screenshot shows a dialog box titled "Add New Patient". It has the following fields and options:


- Last name:** Text input field containing "Thomas".
- First name:** Text input field containing "Benjamin".
- ID number:** Text input field containing "338271".
- Sex:** Radio button selection with "Male" selected and "Female" unselected.
- DOB:** Three dropdown menus for day (18), month (January), and year (1985).
- Buttons:** "Cancel" (with a red X), "Use anonymous patient", and "OK" (with a green checkmark and highlighted by a yellow circle).

Şekil 3-3. Hasta Bilgilerini Gir

- "İsimsiz hasta kullan" seçiminin yapılması halinde soyad alanı, isimsiz olarak doldurulacaktır ve artan sayılarda da "ad" alanını dolduracaktır.
- Hasta bilgileri tamamlandıktan sonra "Tamam" (OK) düğmesi kullanılabilir hale gelecektir.
- Hastalar, her zaman eklenebilir ve "Tamam" (OK) düğmesine basıldıktan sonra veritabanında kaydedilir.

3.8 Yeni Tedavi Planı Oluştur


- Hasta Veritabanından tedavi edilecek hastayı seçin
- Başlamak için “Yeni tedavi planı oluştur” seçeneğine basın

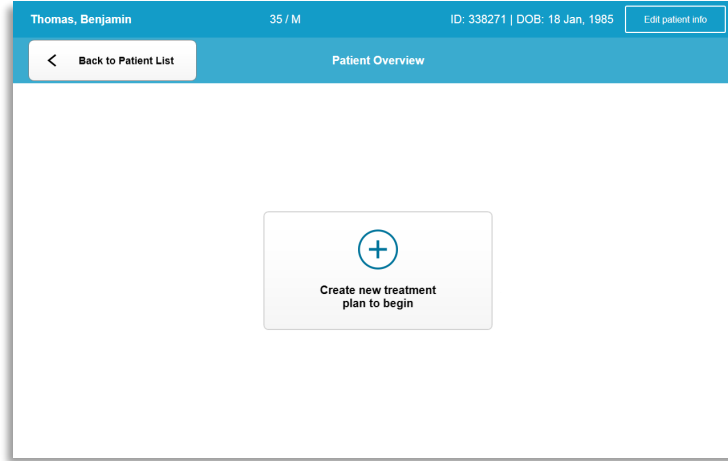

Şekil 3-4. Yeni Tedavi Planı Oluştur

3.8.1 Tedavi Edilecek Göz Seçin

- Tedavi etmek istediğiniz gözü seçin: OD ya da OS
- Göz seçimi yapıldığında alan, Şekil 3-5'te gösterildiği şekilde mavi olarak belirtilecektir.

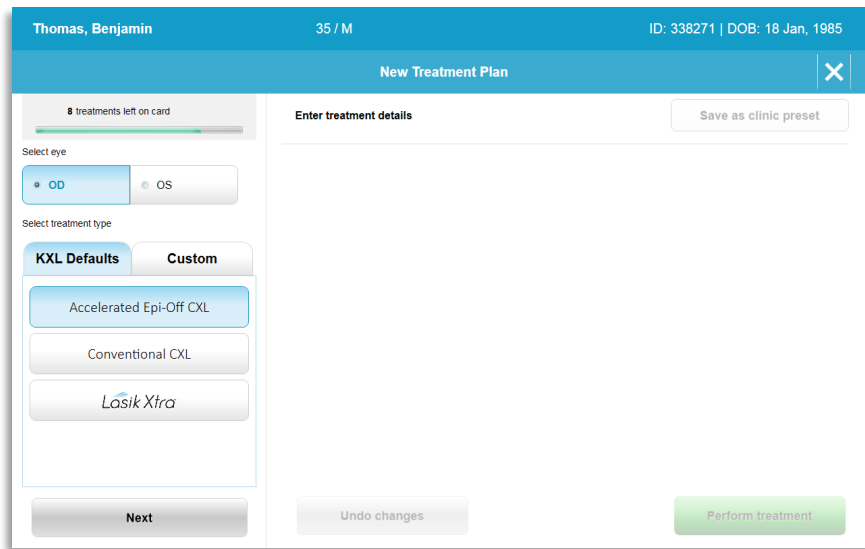

Şekil 3-5. Göz Seç

3.8.2 KXL Varsayılan Tedavi Türünün Seçilmesi

- Sistem, Şekil 3-5'te gösterildiği şekilde 3 KXL Varsayılan tedavi planı ile önceden programlanır.
 - Hızlandırılmış Epi-Off CXL
 - Konvansiyonel CXL
 - LASIK Xtra
- Tedavi parametreleri, KXL Varsayılan tedavi planları için ön ayarlıdır.
- İstenen KXL Varsayılan tedavi planını seçin ve ardından devam etmek için Şekil 3-6'da gösterildiği şekilde "Tedavi Gerçekleştir" seçimi yapın.

Şekil 3-6. Varsayılan bir Tedavi Planı Gerçekleştir

3.8.3 Özel Tedavi Planları

- KXL Varsayılan planların herhangi biri, enerji dozunu, irradyasyon veya diğer tedavi parametrelerini değiştirmek için düzenlenebilir, ardından "Özel" (Custom) tedavi planı olarak gelecekte kullanmak üzere kaydedilebilir.
- Başlangıç noktası olarak KXL Varsayılanı seçin veya yeni, özel bir plan oluşturmak üzere "Özel" (Custom) tedavi türü sekmesini seçin.
 - KXL Varsayılan seçimi yapılması halinde "Özel" (Custom) tedavi türü sekmesine kaydetmek üzere "Klinik ön ayar olarak kaydet" (Save as clinic preset) tuşuna basın.
 - Klinik önceden ayarlanmış tedavi planı için bir ad girin.

Şekil 3-7. Klinik Önceden Ayarlanmış Tedavi Planı Kaydet

- "Tamam" (OK) seçimi yapın, ardından "Özel" (Custom) tedavi türü sekmesinden yeni klinik ön ayarlanmış tedavi planı seçin
- Bireysel parametreler, Özel tedavi planlarında düzenlenebilir.
- Belirli parametreler içerisine basın ve istenen alanı artırmak veya azaltmak için okları kullanın.
- Gelecekte aynı özel tedavi planı kullanmak istenirse "Değişiklikleri kaydet" (Save changes) seçimi yapın.

3.8.4 Özel Tedavi Parametrelerinin Değiştirilmesi

- Sürekli veya Darbeli olmak üzere iki UV tedavi modu vardır.
Sürekli Mod: UV çıkışı, UV işlemi süresince sabittir.
Darbeli Mod: UV çıkışı, kullanıcının seçtiği aralıklarla AÇIK ve KAPALI duruma getirir.
- Aşağıdaki örnekte kullanıcı, Şekil 3-8'de gösterildiği gibi "UV İletimi" (UV Delivery) seçeneğinin sağındaki açılır menüye basarak "Sürekli" (Continuous) UV tedavi modunu seçer.

Thomas, Benjamin 35 / M ID: 338271 | DOB: 18 Jan, 1985

New Treatment Plan

8 treatments left on card

Select eye

OD OS

Select treatment type

KXL Defaults Custom

CXL Treatment Custom

my treatment

Change treatment type Undo changes Perform treatment

OD - my treatment Save changes

Formulation: VibeX Rapid

Riboflavin induction time: 10 min 0 sec

UV irradiance: 30 mW/cm²

Total UV dose: 7.2 J/cm²

UV delivery: Continuous

Total treatment time: 4 min 0 sec

Şekil 3-8. Özel Tedavi Planı – Sürekli UV Modu

- Diğer istenen Özel tedavi parametrelerini girin:
 - Toplam UV dozu*
 - UV irradyasyon (3 – 45 mW/cm²)

NOT: Toplam tedavi süresi otomatik olarak hesaplanıp görüntülenir.

* Kullanıcı 0,1 J/cm²lik artışlarla UV dozunu seçebilir. Doz aralığı, RFID kartı ile kontrol edilir.

- “Tedavi gerçekleştir” (Perform treatment) seçimi yaparak tüm tedavi parametrelerini inceleyin ve onaylayın.

3.9 Tedavinin Başlatılması

- Hasta veritabanından hastayı seçin.
- Bir tedavi planının oluşturulmuş olması halinde “Tedavi gerçekleştir” (Perform treatment) seçimi yapın.

3.9.1 Tedavi / RFID Aktivasyon Kartı Takın

- Aktivasyon kartını RFID yuvasına tamamen takın ve yerinde bırakın.



Şekil 3-9. KXL Aktivasyon Kartını Takın


3.9.2 Tek Kullanımlık Aktivasyon Kartları

- Okuma tamamlanana kadar kartı yerinde tutun.



Şekil 3-10. Aktivasyon Kartının Okunması

- Kullanıcı, Şekil 3-11'de gösterildiği şekilde kartta sadece 1 tedavi kaldığına dair uyarı alacaktır.

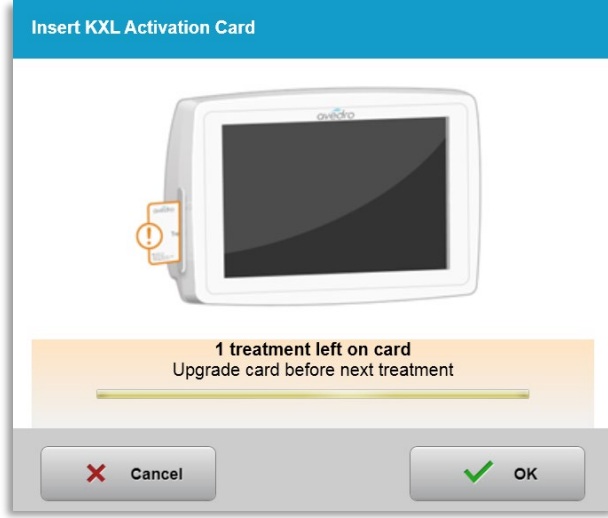


Şekil 3-11. Kart Tedavi Bakiyesi

- Sistem tarafından kart okunduğunda ve tedavi kredisi kabul edildiğinde "Tamam" (OK) düğmesi yanacak. Kullanıcı isterse bu anda kartı çıkarabilir.


3.9.3 Çok kullanımlı Aktivasyon Kartları

- Çok kullanımlı aktivasyon kartı girildiğinde ekranda kartta kalan tedavilerin sayısı gösterilecektir.
- Aktivasyon kartı, çıkarılabilir veya RFID yuvasında kalabilir ve sonraki kullanım için saklanabilir.

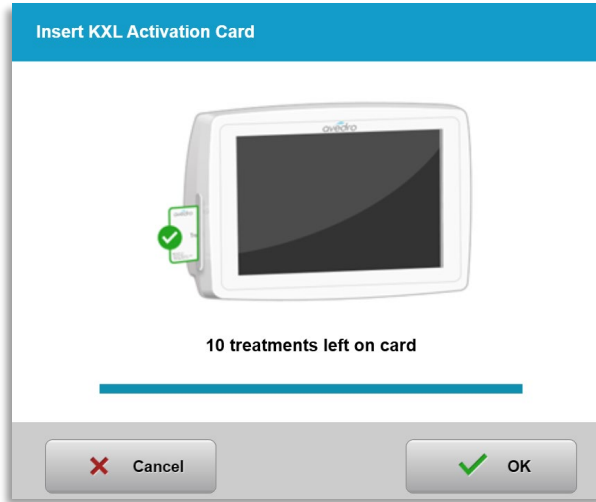

Şekil 3-12. Kart Bakiyesi: Kalan Tedaviler


- Tedavi kartında sadece bir tedavinin kalmış olması halinde sistem, Şekil 3-11'de gösterildiği şekilde kullanıcıyı "Bir sonraki tedaviden önce kartı yükseltin" olarak bilgilendirecektir.
- Kartta tedavilerin kalmaması halinde sistem, Şekil 3-13'te gösterildiği şekilde farklı bir kart girdirmesi için kullanıcıyı uyarır.

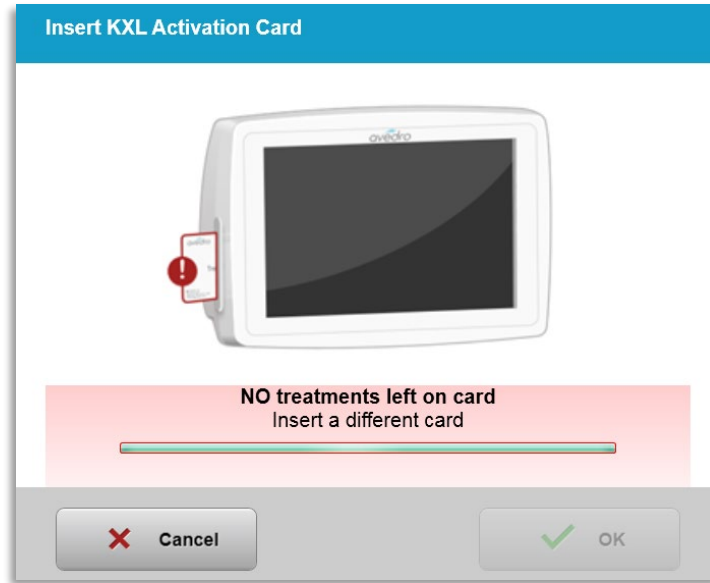

Şekil 3-13. Tedavi Kalmadı

3.9.4 RFID Kart ile kontrol edilen Sınırlar

- o Kullanıcının UV doz aralığını RFID kartı ile kontrol edilen izin verilen değer(ler) dışında ayarlaması halinde "Tedavi gerçekleştir" (Perform treatment) seçimi yapıldıktan sonra "Geçersiz tedavi parametreleri" (Invalid treatment parameters) içerikli bir mesaj görünecektir.

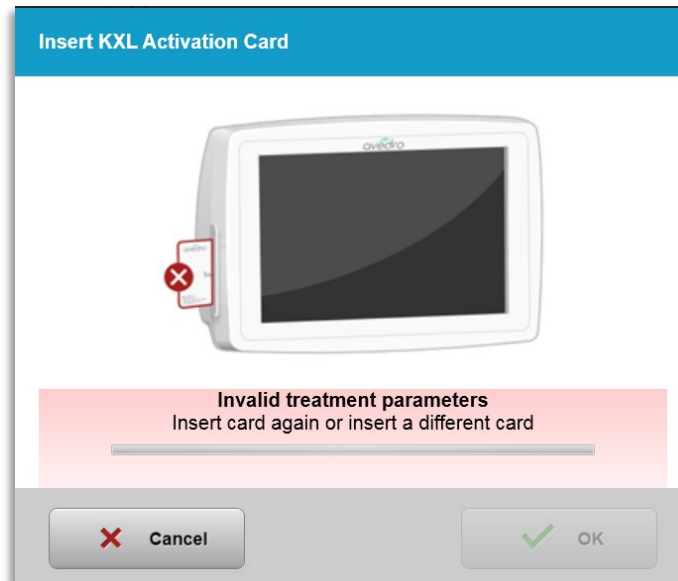


Şekil 3-14. Geçersiz Tedavi Parametreleri

- o Uygun parametreleri girmek için Tedavi Parametreleri bölümüne geri dönün.
- o RFID kartı ile kontrol edilen izin verilen değer(ler) dışında tedavi parametreleri programlarken kullanıcının tedavinin kartının girdirilmiş olması halinde aşağıdaki mesaj görünecek ve Şekil 3-15'te gösterildiği gibi "Tedavi gerçekleştir" (Perform treatment) seçeneği seçilemeyecek.

Şekil 3-15. Geçersiz Tedavi Parametreleri


3.9.5 Uzaktan Kumanda Hizalamasını Senkronize Et

- o Senkronizasyon hizalama uzaktan kumanda mesajı, Şekil 3-16'da gösterildiği gibi 15 saniye boyunca ekranda görünecektir.

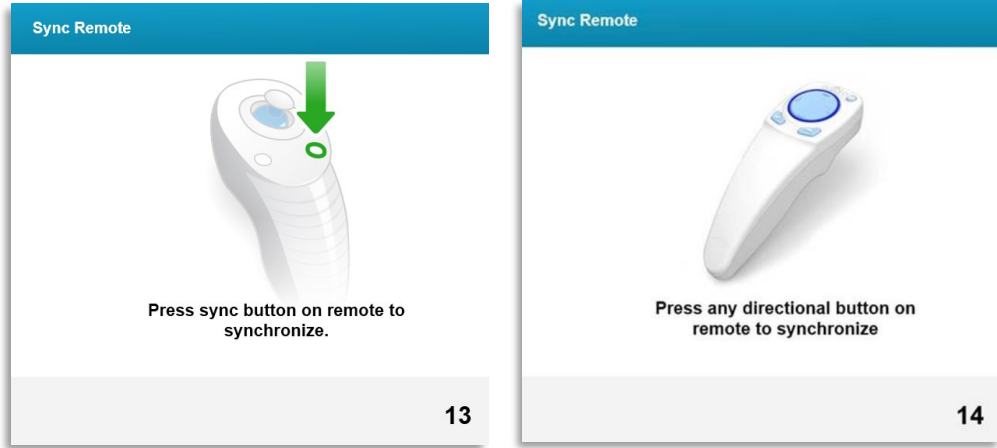


Şekil 3-16. Uzaktan Kumanda Senkronize Et

- o Güncellenmiş Uzaktan Kumandayı kullanmanız halinde (bkz. Şekil 2-3), uzaktan kumandayı 15 saniyelik zaman çerçevesi içerisinde senkronize etmek için herhangi bir yön düğmesine basın. Uzaktan kumanda kullanımının istenmesi halinde her bir prosedür için bu gereklidir.
- o Orijinal Uzaktan (bkz. Şekil 2-3) kullanılırsa uzaktan kumandayı 15 saniyelik bir zaman çerçevesi içerisinde senkronize etmek için uzaktan kumanda üzerinde "S" ile gösterilen senkronizasyon düğmesine basın. Senkronizasyon düğmesinin konumu için Şekil 3-17'ye bakın. Uzaktan kumanda kullanımının istenmesi halinde her bir prosedür için bu gereklidir.

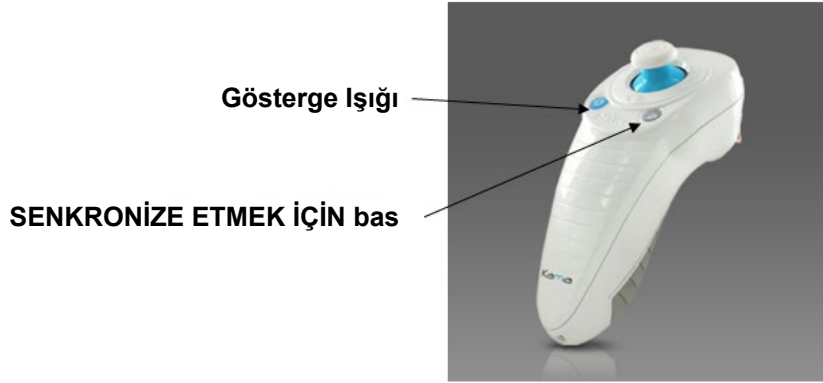

Şekil 3-17. Sistem Kurulum Durumu

- o 15 saniyelik senkronizasyon zaman çerçevesi boyunca her 2 saniyede bir sistem uyarı verecek.
- o 15 saniyelik zaman çerçevesi içerisinde senkronizasyon düğmesine basılmazsa Şekil 3-18'de gösterildiği gibi ekranda "Uzaktan Senkronizasyon Hizalama" ifadesinin bulunduğu bir mesaj görünecektir.
- o Uzaktan kumandayı yeniden senkronize etmeyi denemek için "Tamam" (OK) düğmesine basın veya Tedavi İptal Et seçimi yapın.

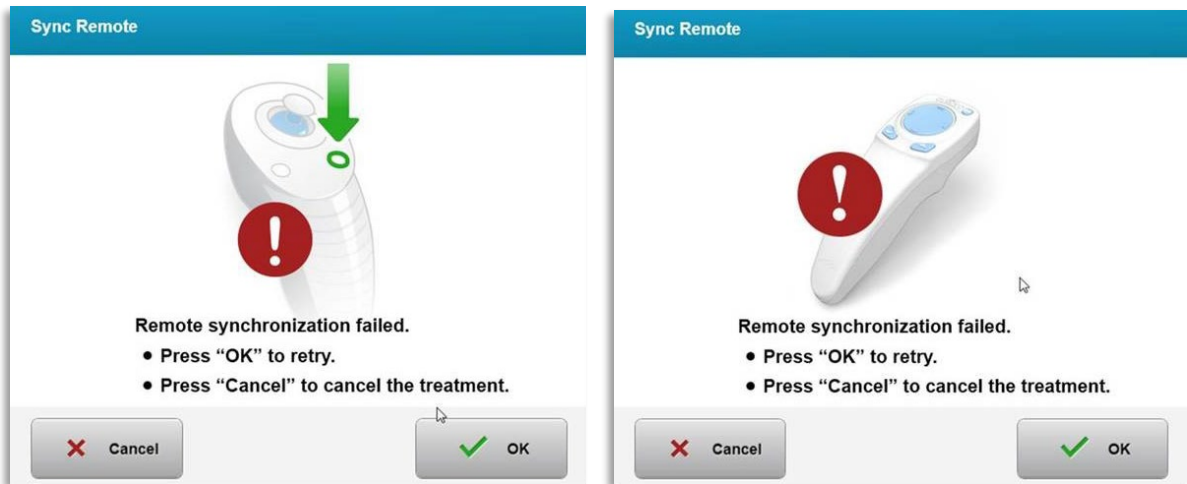

Şekil 3-18. Senkronizasyon İşlemi Zaman Aşımına Uğradı

- o Orijinal Uzaktan Kumanda Gösterge Işığının çeşitli durumları, Şekil 3-19'da gösterilmektedir.
 - Sürekli şekilde yanan uzaktan kumanda Gösterge Işığı, uzaktan kumandanın KXL ile senkronize edildiği anlamına gelir.
 - Gösterge Işığının sürekli olarak yanıp sönmesi halinde uygun çalışmayı sağlamak için uzaktan kumandanın pillerini derhal değiştirin.

Indicator Light Status	Meaning
ON	Actively Synchronized with the device
Blinking once per second for 10 seconds	Disconnecting Sync (After procedure)
Blinking constantly, twice per second	Replace batteries immediately (2 AAA)

Şekil 3-19. Uzaktan Kumanda Gösterge Işığının Durumu ve Anlamı

- o Güncellenmiş Uzaktan Kumanda Başparmak Paneli Gösterge Işığının ve Pil Gösterge Işığının çeşitli durumları Şekil 3-20'de gösterilmektedir.

Başparmak Paneli Gösterge Işığının Durumu	Anlam
Aydınlatma yok	Kapalı
Döner mavi ışık	Senkronize ediliyor
Sabit mavi ışık	Senkronize edildi ve Hazır
Sabit turuncu ışık	Senkronizasyon kayboldu
Pil Gösterge Işığının Durumu	Anlam
Aydınlatma yok	Kapalı
Sabit mavi ışık	Pil Tamam
Sabit turuncu ışık	Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Yanıp sönen turuncu ışık	Pilin değiştirilmesi gerekir

Şekil 3-20. Uzaktan Kumanda Gösterge Işığının Durumu ve Anlamı

NOT: KXL sistemi, uygun UVA kalibrasyonunu doğrulamak için her tedaviden önce dahili bir otomatik sınaama gerçekleştirir. Dahili otomatik sınaama, her tedavi için doğru UVA düzeylerinin iletilmesini sağlamak için yedek bir optik sensör seti kullanır. Dahili otomatik sınaamanın başarısız olması halinde bir hata mesajı oluşturulur ve tedavi devam edemez. Bunun olması halinde distribütörünüz veya Müşteri Hizmetleri ile derhal irtibat kurun.


3.10 Hastanın Hazırlanması

- Hastanın muayene yatağına veya sandalyesine düz şekilde uzandığından veya sırtını yaslayarak oturduğundan emin olun. Başının bir baş dayanağına yaslanması gerekir.

- Masayı veya sandalyeyi ve baş dayanağını, hastanın tedavi süresince başını hareket ettirmeden rahatça dinlenebileceği şekilde ayarlayın.
- Standart klinik tekniği kullanarak bir kapak spekulumu ve isteğe bağlı örtüler uygulayın. NOT: Ekrandaki göz görüntüleri kapak spekulumunu tasvir etmez.

3.10.1 Riboflavin, İndüksiyon ve Hizalamanın Uygulanması

- o Riboflavin'i Riboflavin Kullanım Talimatına (KT) uygun olarak tedavi gözüne uygulayın ve "Zamanlayıcıyı Başlat" (Start Timer) seçeneğine basın.

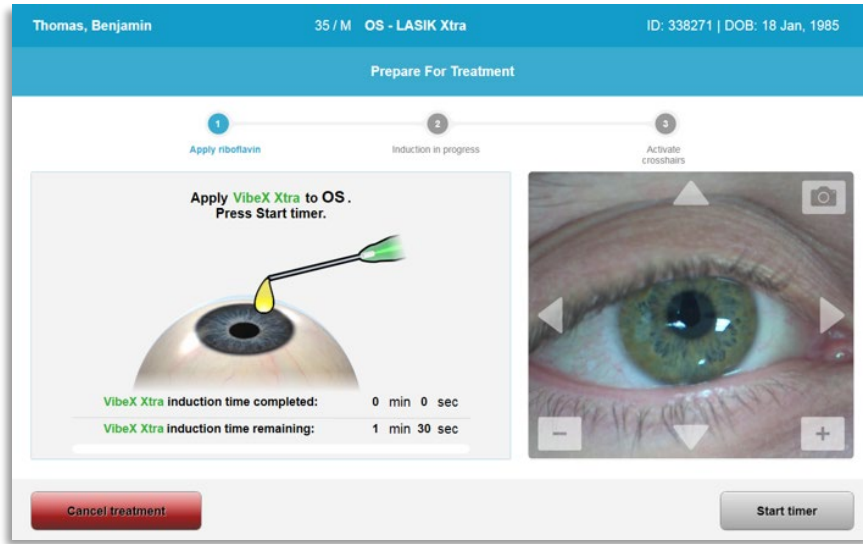


Şekil 3-21. Tedavi için Hazırlan: Riboflavin uygula




DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Riboflavin, bu kılavuzda açıklanan KXL Sistemi'nin bir parçası değildir. Ayrıntılar için lütfen Riboflavin Kullanım Talimatına bakın.

- o Kırmızı hizalama lazerleri, Şekil 3-22'de gösterildiği gibi İndüksiyon dönemi sonundan 30 saniye önce açılacak.

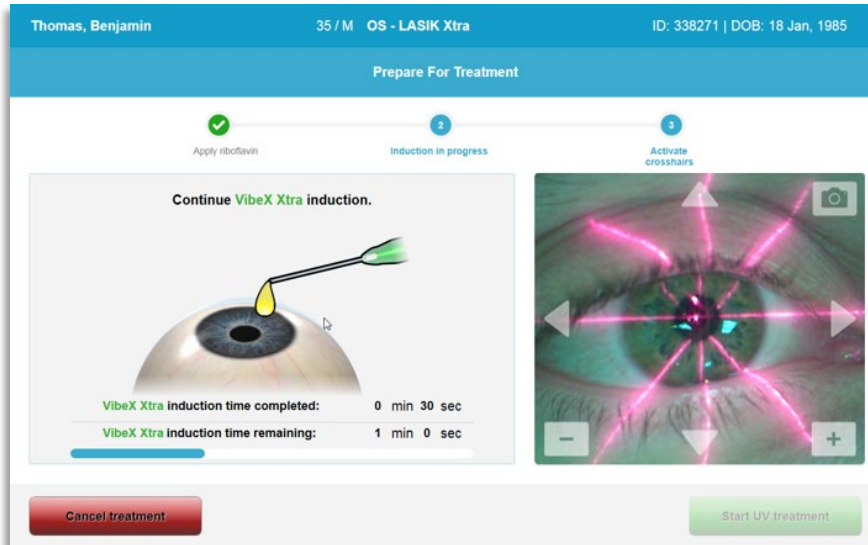


Şekil 3-22. İndüksiyon Sırasında Artı İmleçlerini Hizala

- o KXL'de Şekil 3-23'te gösterildiği gibi iki hizalama lazeri vardır.
 - X ve Y eksenini konumlandırma için kırmızı artı imleci.
 - Z eksenini konumlandırması için ikinci bir kırmızı artı imleci.
- o **NOT:** Artı imleçleri, görünüm olarak farklılık gösterebilir. Daha kalın, daha ince, daha uzun veya daha kısa görünebilirler.

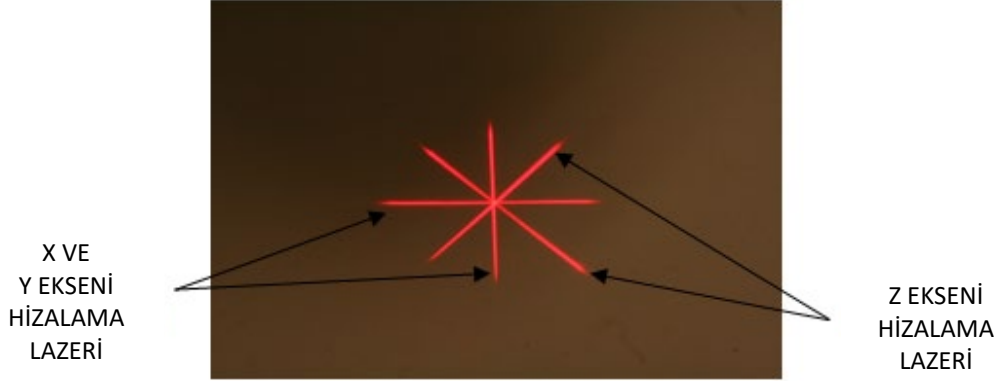

Şekil 3-23. Kırmızı İmleçlerin Hizalanması – X ve Y Eksenleri ve Z Eksenini


- o Hizalama lazerleri açıldığında artı imleçlerini tedavi edilecek göz ile hizalayın.
 - KXL başını, X/Y eksenlerinin kırmızı artı imleçleri, göz bebeğinin merkeziyle hizalanana kadar manuel olarak geri - ileri ve soldan sağa hareket ettirin.
 - Z eksenini ikinci kırmızı artı imlecini ilk kırmızı artı imlecinin merkezi ile hizalamak için KXL başını yukarı ve aşağı manuel olarak hareket ettirin.
 - Kablosuz uzaktan kumanda kullanarak veya ekrandaki oklara basarak gerektiğinde hizalamaya ince ayar yapın.
- o **NOT:** Uzaktan kumanda kullanırken doğru hizalama için KXL başının üzerindeki Avedro logosunun kullanıcıya dönük olması gerekir. Şekil 3-24, hizalama süreci boyunca kullanılmak üzere uzaktan kumanda işlevlerini gösterir.

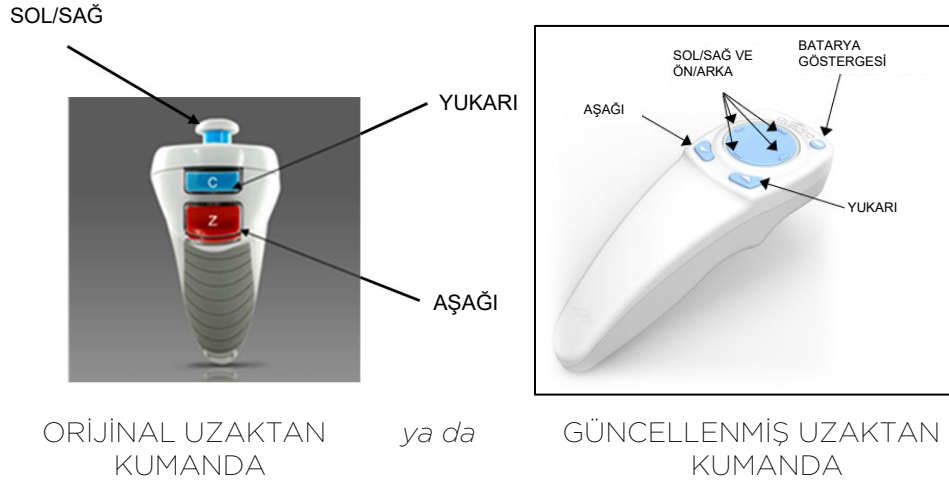

Şekil 3-24. Uzaktan İşlevler

3.11 Tedavinin Başlatılması

- Riboflavin uygulaması, İndüksiyon ve Artı İmleçlerinin Hizalanması tamamlandığında Şekil 3-25'te gösterildiği gibi "UV tedavisini başlat" düğmesine basarak tedaviyi başlatın.

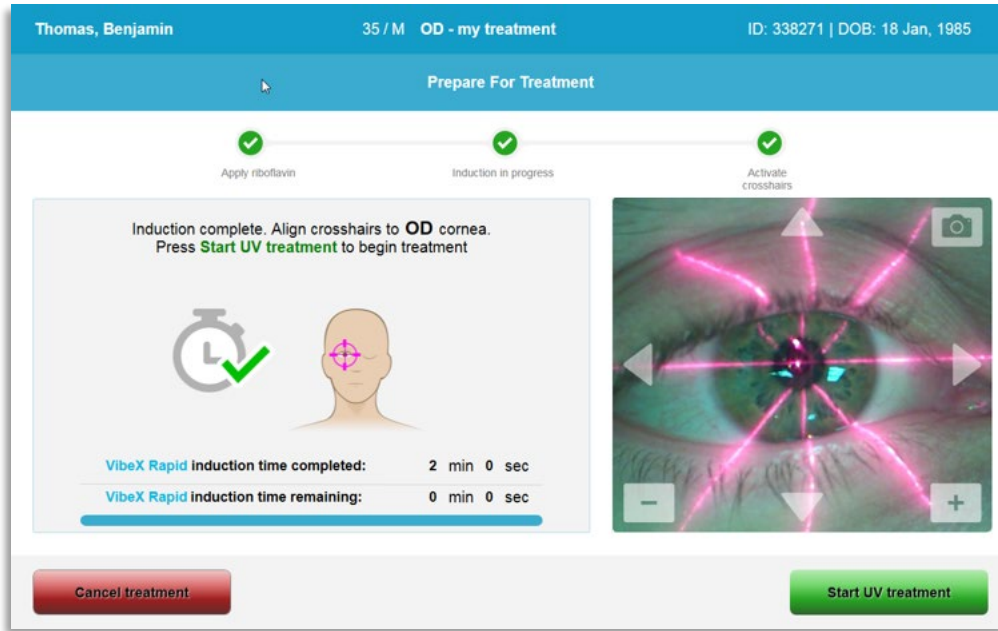

Şekil 3-25. UV Tedavisini Başlat

- Hastanın tedavi boyunca kırmızı X ve Y hizalama artı imlecinde sabitlenmiş olması gerekir.
- Tedavi sırasında hastanın hareketsiz olması gerekir.



UYARI: Sadece ışık duyarlılaştırıcı uygulandıktan sonra tedavileri başlatın.




DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Optik başlığındaki Avedro logosunun rengi maviden yeşile doğru yanıp söndüğünde UV ışığı yayılır.



UYARI: KXL Sisteminin ve muayene yatağının ya da sandalyesinin sabit olduğundan ve hizalama sonrasında ve tedavi sırasında hareket etmediğinden emin olun.

3.12 Tedavinin İzlenmesi

- Kornea üzerindeki ilgi gerektiren alanın, UVA ışığı ile yanıp yanmadığını sürekli olarak kontrol edin ve gerektiğinden kablosuz uzaktan kumanda veya ekrandaki okları kullanarak ayarlayın.

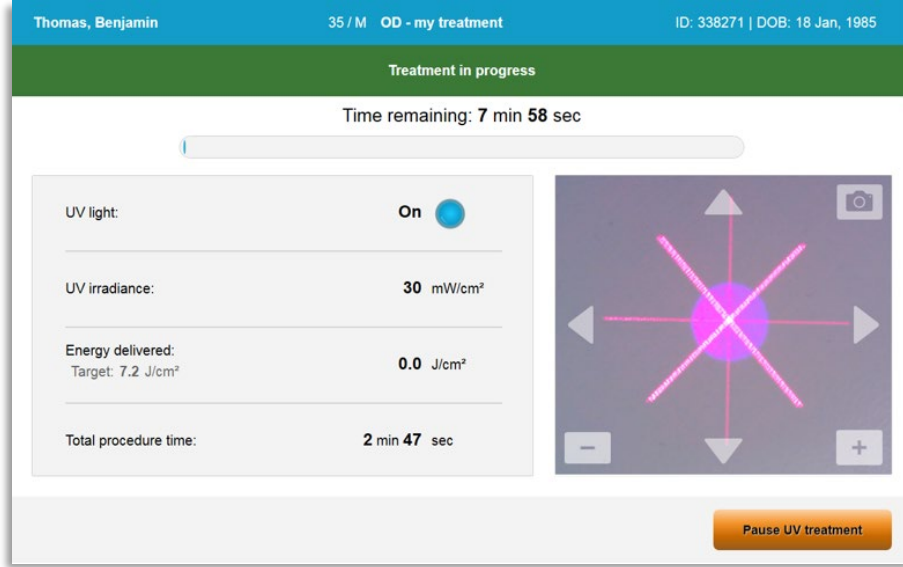


Şekil 3-26. Tedavi Devam Ediyor Ekranı

- o **NOT:** Darbeli Tedavi modu kullanırken UVA ışığı, KAPALI dönemlerde görünür olmayacaktır. Kullanıcı Arayüzü, bu döngüler sırasında "UV KAPALI" olarak değişmeyecektir.

3.13 Tedavinin Duraklatılması

- Kullanıcı tarafından programlanan zamanlayıcı sona erdiğinde tedavi otomatik olarak sonlanır.
- Kullanıcı, tedaviyi sonlandırmaya veya kesmeye karar verebilir. Bu tür durumlarda UV ışığı, "UV tedavisini duraklat" (Pause UV treatment) düğmesine basarak KAPALI (OFF) konuma getirilebilir.

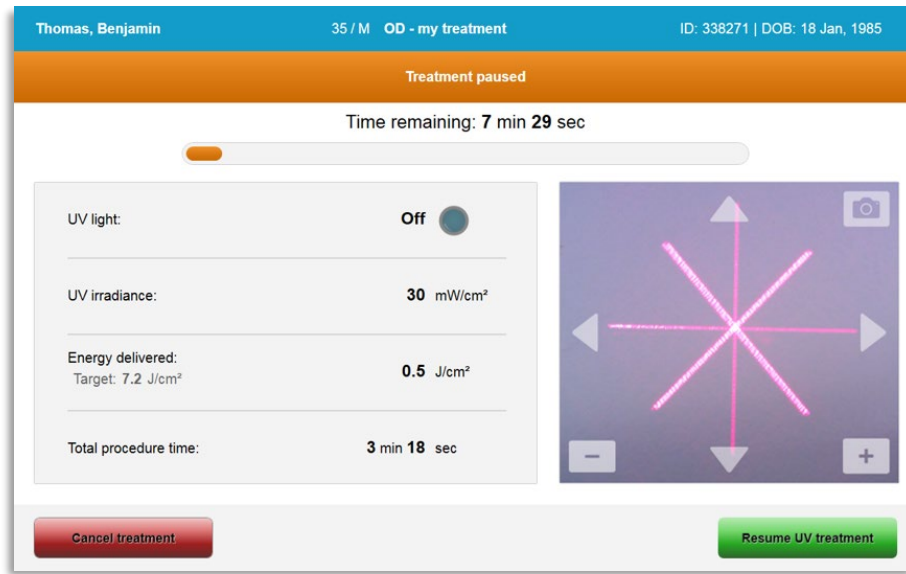


Şekil 3-27. Tedavi Duraklatıldı Ekranı

- Tedaviyi iptal etmek veya sürdürmek için sırasıyla "Tedaviyi iptal et" (Cancel treatment) veya "UV tedavisini sürdür" (Resume UV treatment) seçeneğini seçin. Bir oturumun iptal edilmesi halinde Bölüm 3.14'e bakınız.


3.14 Tedavi Ortasında İptal

- Şekil 3-28'de gösterildiği gibi tedavinin ortasında "Tedaviyi iptal et" (Cancel treatment) seçeneği seçildiğinde bir uyarı açılır iletisi görünecek.
- Tedavi iptalini onaylamak için "Evet" (Yes) seçeneğini seçin.

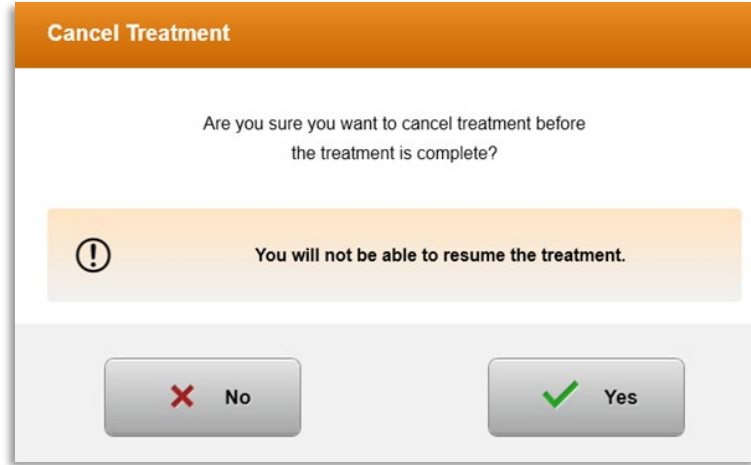


Şekil 3-28. Kısmi Tedaviyi İptal Et Seçeneğini Onayla

- Tedavi iptalinin onaylanması halinde Şekil 3-29'da gösterildiği gibi ekranda "Tedavi İptal Edildi" (Treatment Cancelled) mesajı görünecek.

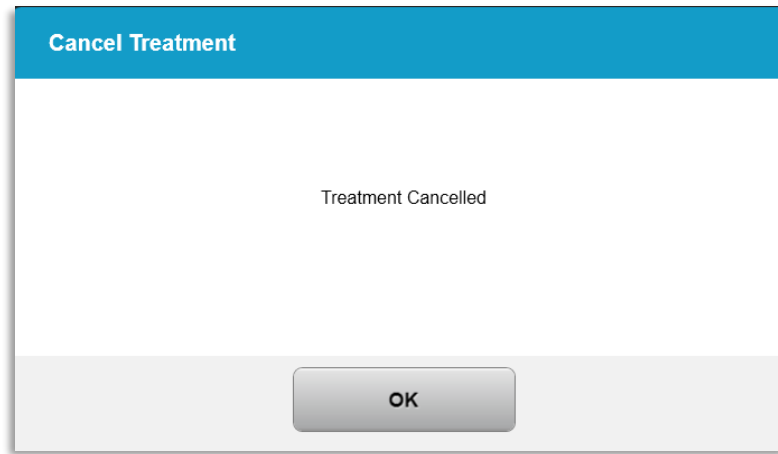

Şekil 3-29. Tedavi İptal Edildi Onaylama


- Tedaviyi İptal Et onaylama ekranında "Tamam" (OK) seçeneğini seçin.
- Kısmi Tedavi bilgileri, Şekil 3-30'da gösterildiği gibi görüntülenecek.

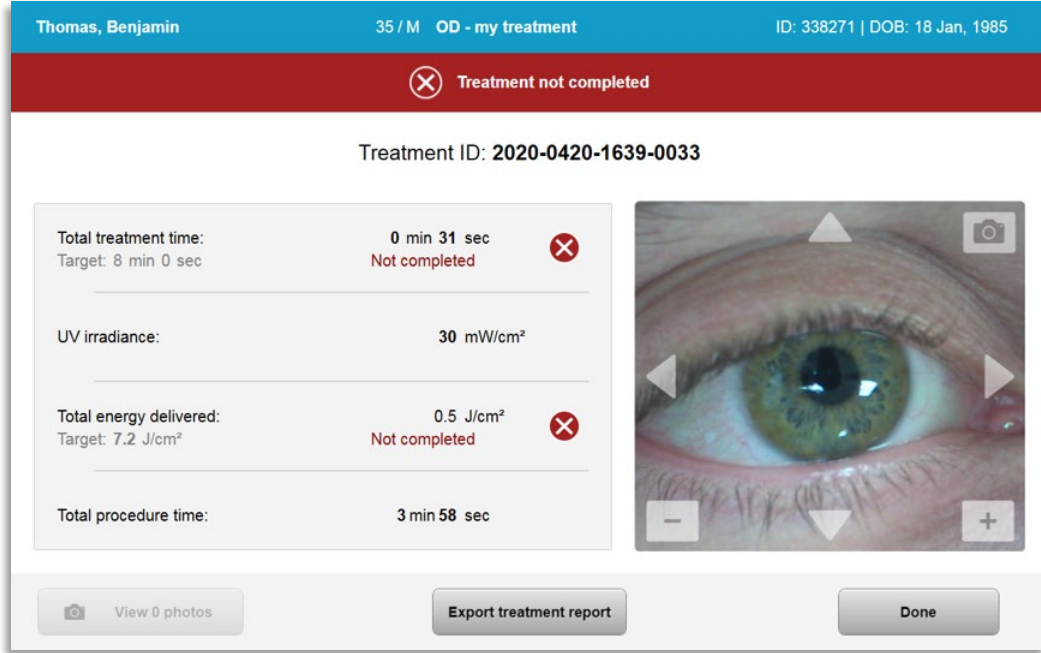

Şekil 3-30. Kısmi Tedavi Tamamlanmadı

3.15 Görüntülerin Yakalanması


- Görüntüler, tedavi sürecinde herhangi bir aşamada alınabilir.
- Bir görüntü elde etmek için Şekil 3-31'de gösterildiği gibi göz görüntüsünün sağ üst köşesindeki kamera düğmesini seçin.
- Görüntü otomatik olarak kaydedilir ve tedavi sonrasında incelenebilir.

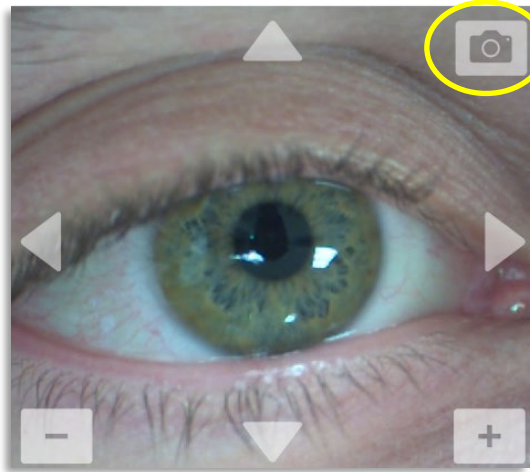

Şekil 3-31. Görüntülerin Yakalanması

3.16 Tedavi Tamamlandı

- Tedavi tamamlandığında tedavi parametrelerinin bir özeti görüntülenecek ve ekranda Şekil 3-32'de gösterildiği gibi "Tedavi tamamlandı" (Treatment complete) mesajı gösterilecek.

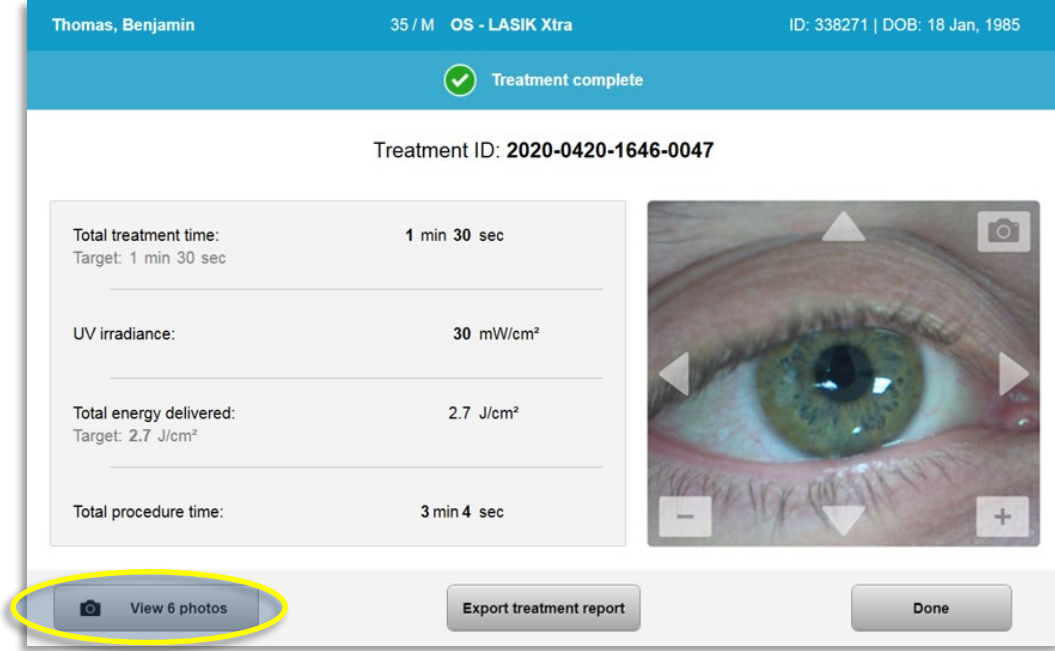

Şekil 3-32. Tedavi Tamamlandı Ekranı


- Hasta alanından cihazı dikkatli şekilde çıkarın.
- Normal ameliyat sonrası bakımla takip edin.
- Spekulumu kaldırın.

3.17 Görüntülerin İncelenmesi

- Tedavi boyunca alınan tüm görüntüler, tedavi sonrası incelenebilir.
- Şekil 3-32'de gösterildiği gibi fotoğraf galerisi girmek için "Fotoğrafları Görüntüle" (View Photos) seçeneğini seçin.


3.18 Fotoğrafların Silinmesi

- Tedavi sırasında çekilen fotoğraflar silinebilir.
- Fotoğraf Galerisinde Şekil 3-33'te gösterildiği gibi silinecek fotoğrafın yanındaki çöp kutusu simgesini seçin.

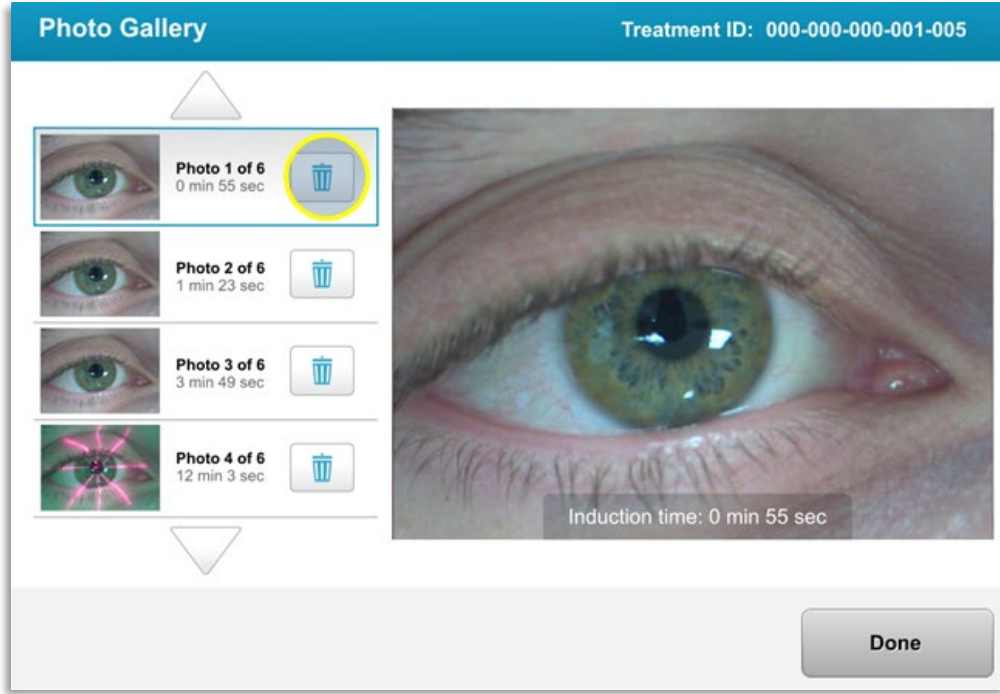

Şekil 3-33. Silmek için Çöp Kutusu seçimi yapın


- Silinmek üzere fotoğraf seçildiğinde fotoğrafı silmek için “Evet” seçeneğini seçin ya da görüntüyü tutmak için “Hayır” seçeneğini seçin.

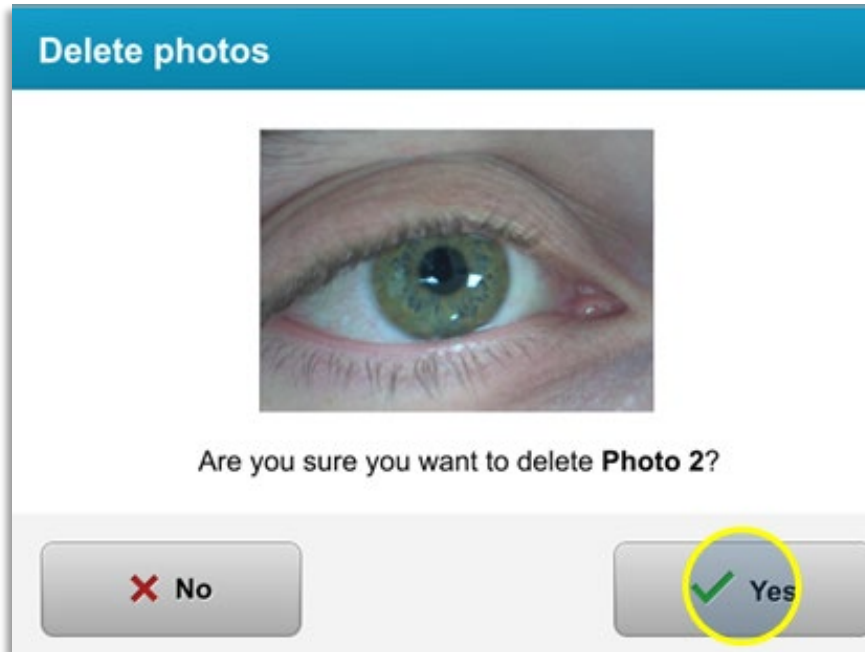

Şekil 3-34. Silmek için Evet seçimi yapın

- Silinme onaylandığında fotoğraf geri alınamaz.


- Hangi fotoğrafların tedavi raporunda görüntüleneceğini onaylamak için "Yapıldı" seçeneğini seçin.

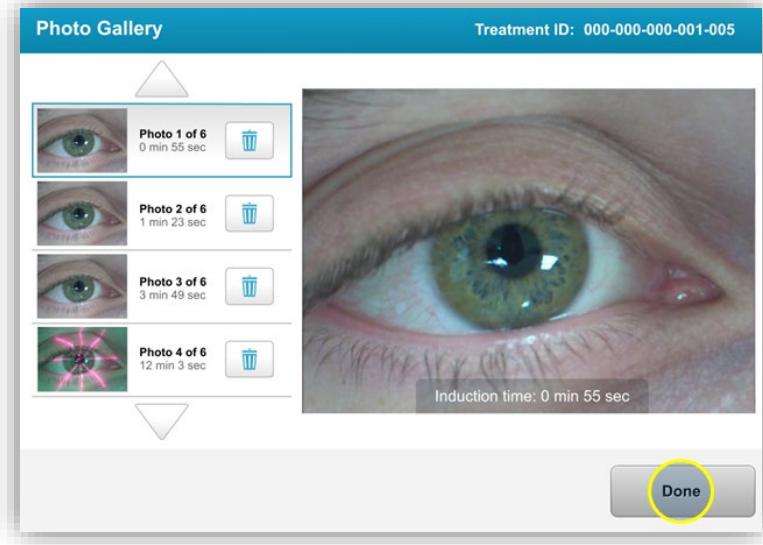

Şekil 3-35. Seçim Yapıldı

3.19 Hasta Tedavi Raporu

- Hasta bilgilerini, tedavi ayrıntılarını, tedavi sırasında çekilen fotoğrafları ve notları içeren tedavi raporu oluşturulur. Örnek bir rapor, Şekil 3-36'da gösterilmektedir.
- Tedavi raporları, tedaviler duraklatılsa veya iptal edilse bile oluşturulur.
- Tamamlanan fazların bitişiğinde yeşil bir onay işareti listelenir.
- Kırmızı bir "X" işareti, eksik fazların bitişiğinde listelenecek.



Treatment report

Treatment ID: 2020-0420-1639-0033 | System serial number: KXL171117

👤

Patient info

Thomas, Benjamin 35 / M
ID: 338271 | DOB: 18 Jan, 1985

📄

Treatment details

Date: 20 April, 2020	Formulation: VibeX Rapid
Time: 16:40	UV delivery: Pulsed
Selected eye: OD	Pulse duration: On: 1.0 sec Off: 1.0 sec
Treatment type: my treatment	

📄

Treatment - Not Complete

UV irradiance:	30 mW/cm ²
Total treatment time: Target: 8 min	0 min 31 sec ✘
Total energy delivered: Target: 7.2 J/cm ²	0.5 J/cm ² ✘
Total procedure time:	3 min 58 sec ✔

Page 1 of 1


Şekil 3-36. Örnek Tedavi Raporu

3.19.1 Bir Hasta Tedavi Raporuna Not Eklenmesi

- Hasta Veritabanı ekranından hastanın adını seçin.
- Hastanın tedavisi hakkında yorumlar girmek için Şekil 3-37'de gösterildiği gibi mesaj simgesine basın.
- Hastanın raporuna yorumlar yapmak için klavye kullanılabilir hale gelecektir. Şekil 3-38, Hasta Raporu içindeki yorumları tanımlar.

Thomas, Benjamin
35 / M
ID: 338271 | DOB: 18 Jan, 1985
Edit patient info

← Back to Patient List
Patient Overview
+ New treatment



OS - LASIK Xtra

Treated On 20 Apr, 2020

📄
💬
🗑️

Total treatment time:
1 min 30 sec

UV irradiance delivered:
30 mW/cm²

Total energy delivered:
2.7 J/cm² (2.7 J/cm²)

Total procedure time:
3 min 4 sec


Şekil 3-37. Yorumlar Simgesi



Şekil 3-38. Yorumlar Bölümü

3.19.2 Tedavi Raporunun Dışarı Aktarılması

- o Raporu USB belleğe kaydetmek için Şekil 3-39'da gösterildiği gibi "Tedavi raporunu dışa aktar" (Export Treatment Report) seçeneğini seçin.
- o Rapor, PDF olarak dışarı aktarılacak.

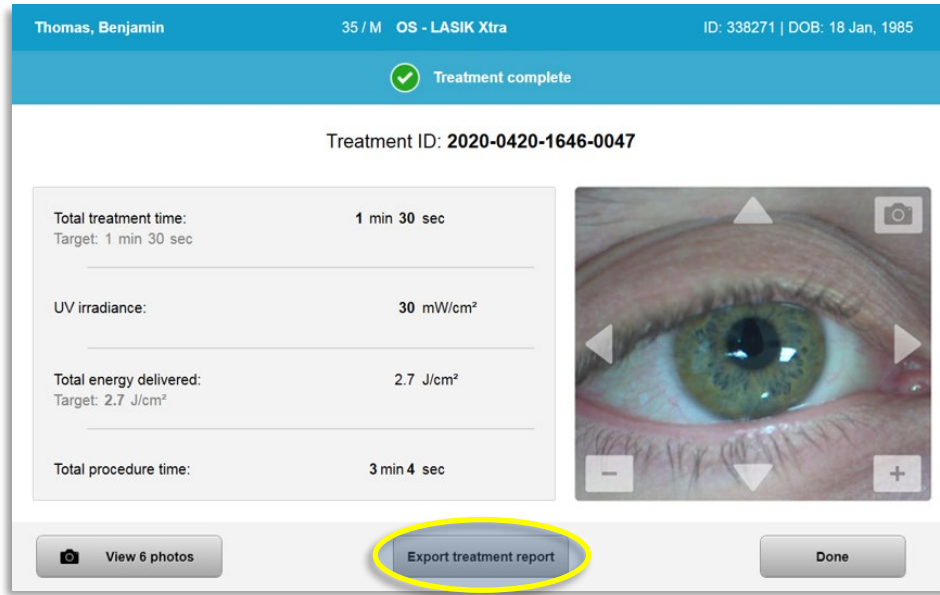


Şekil 3-39. Tedavi Raporunun Dışarı Aktarılması

- o Ekran, Şekil 3-40'ta gösterildiği gibi USB diskini takmak için yönlendirecektir.
NOT: Avedro, hasta verilerini saklamak için USB diski tedarik etmez.



Şekil 3-40. USB Tak

- o USB'nin dolu olması ya da sistemin USB'yi okuyamaması halinde Şekil 3-41'de gösterildiği gibi bir hata mesajı görüntülenecek.

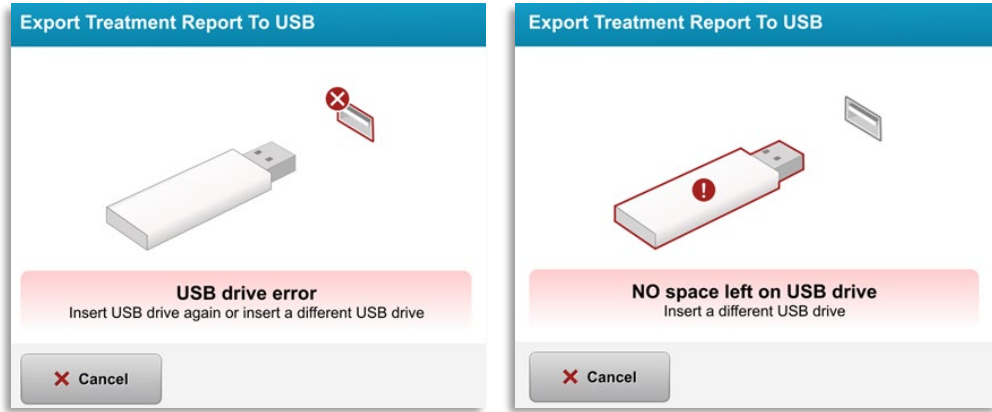

Şekil 3-41. USB Hatası ve USB'de Boş Alan Yok

- o USB ile ilgili sorun olmaması halinde "Tedavi raporu oluşturuluyor" ifadesini içeren bir mesaj görünecek.



Şekil 3-42. Tedavi raporunun oluşturulması

- o Tedavi raporu dışarı aktarıldığında Şekil 3-43'te gösterildiği gibi bir onaylama mesajı görünecektir.



Şekil 3-43. Tedavi raporu dışarı aktarıldı

3.19.3 Tedavi Raporunun Görüntülenmesi

- o Tam tedavi raporu, sistemde veya (dışarı aktarılırsa) USB ile incelenebilir.
- o Eklenen tüm fotoğraflar veya yorumlar, raporda bulunacaktır.



Treatment report

Treatment ID: 2020-0420-1646-0047 | System serial number: KXL171117



Patient info

Thomas, Benjamin 35 / M

ID: 338271 | DOB: 18 Jan, 1985



Treatment details

Date: 20 April, 2020

Formulation: VibeX Xtra

Time: 16:47

UV delivery: Continuous

Selected eye: OS

Treatment type: LASIK Xtra



Treatment - Complete

UV irradiance:

30 mW/cm²

Total treatment time:
Target: 1 min 30 sec

1 min 30 sec



Total energy delivered:
Target: 2.7 J/cm²

2.7 J/cm²




Total procedure time:


3 min 4 sec



Page 1 of 3

Şekil 3-44. Sayfa 1/3: Tedavi Ayrıntıları


Treatment report
Treatment ID: 2020-0420-1646-0047 | System serial number: KXL171117


 **Comments**

Last updated: 20 April 2020, 16:54

Lorem ipsu; dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,


Page 2 of 3


Şekil 3-45. Sayfa 2/3: Yorumlar




Treatment report

Treatment ID: 2020-0420-1646-0047 | System serial number: KXL171117


 **photos (6)**




Induction time: **0 min 56 sec**




Induction time: **1 min 12 sec**




Induction time: **1 min 23 sec**



UV exposure time: **0 min 1 sec**



UV exposure time: **0 min 9 sec**




UV exposure time: **0 min 12 sec**

Page 3 of 3

Şekil 3-46. Sayfa 3/3: Fotoğraflar


3.20 KXL Sisteminin Kapatılması

- Şekil 3-47'de gösterildiği gibi Hasta Listesi ana ekranında "Kapat" seçeneğini seçin.

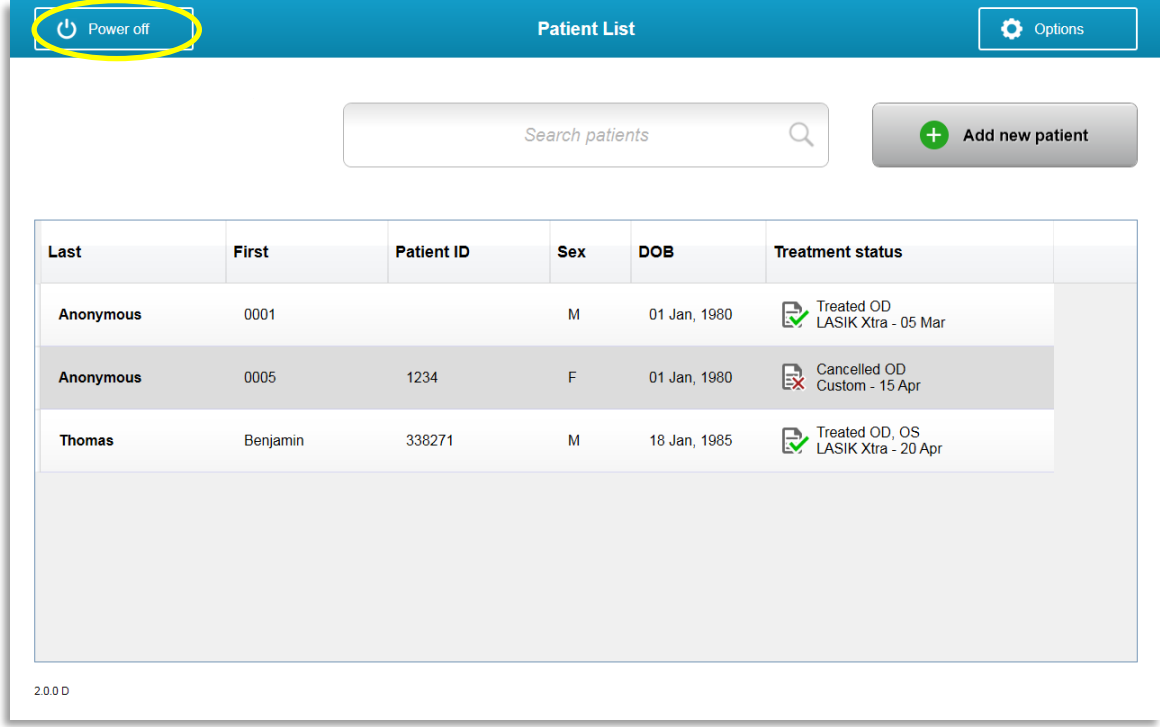

Şekil 3-47. "Kapat" (Power Off) Seçimi Yap


- Şekil 3-48'te gösterildiği gibi "Evet" seçeneğini seçerek sistemi kapatmayı onaylayın.

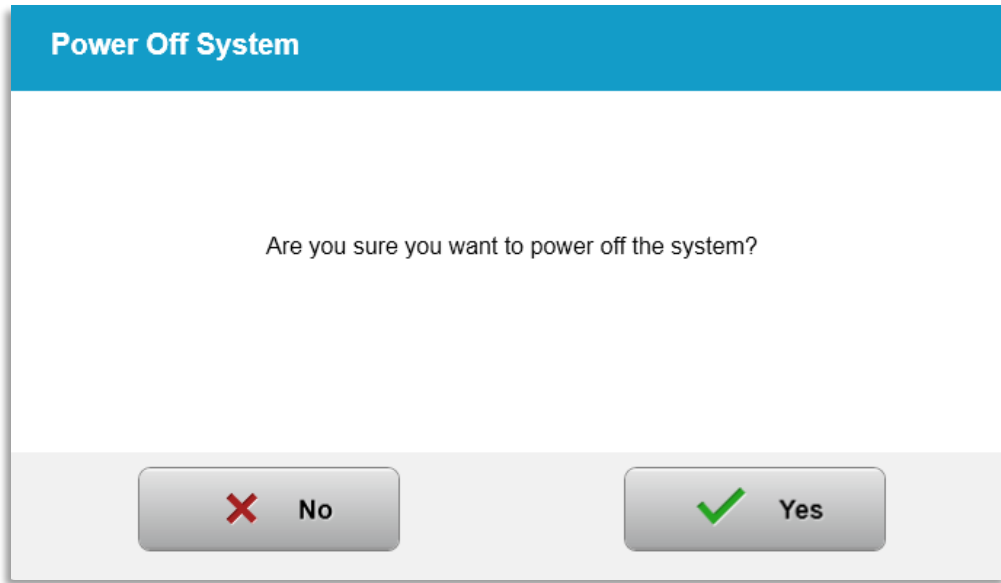

Şekil 3-48. "Kapat" (Power Off) Seçimini Onayla

- Yazılımın kapanmasını ve ekranın kararmasını bekleyin.


- KXL'nin alt tarafındaki ana güç anahtarını Şekil 3-49'da gösterildiği gibi "Kapalı" duruma getirin.

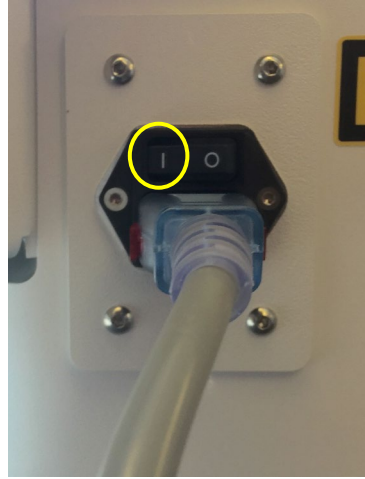

Şekil 3-49. Pozisyonu Kapat

3.21 Seçenekler Menüüne Erişilmesi


- o Hasta Listesi ana ekranından Şekil 3-50'de gösterildiği gibi 4 Seçenek menülerini görüntülemek üzere "Seçenekler" (Options) düğmesine basın.

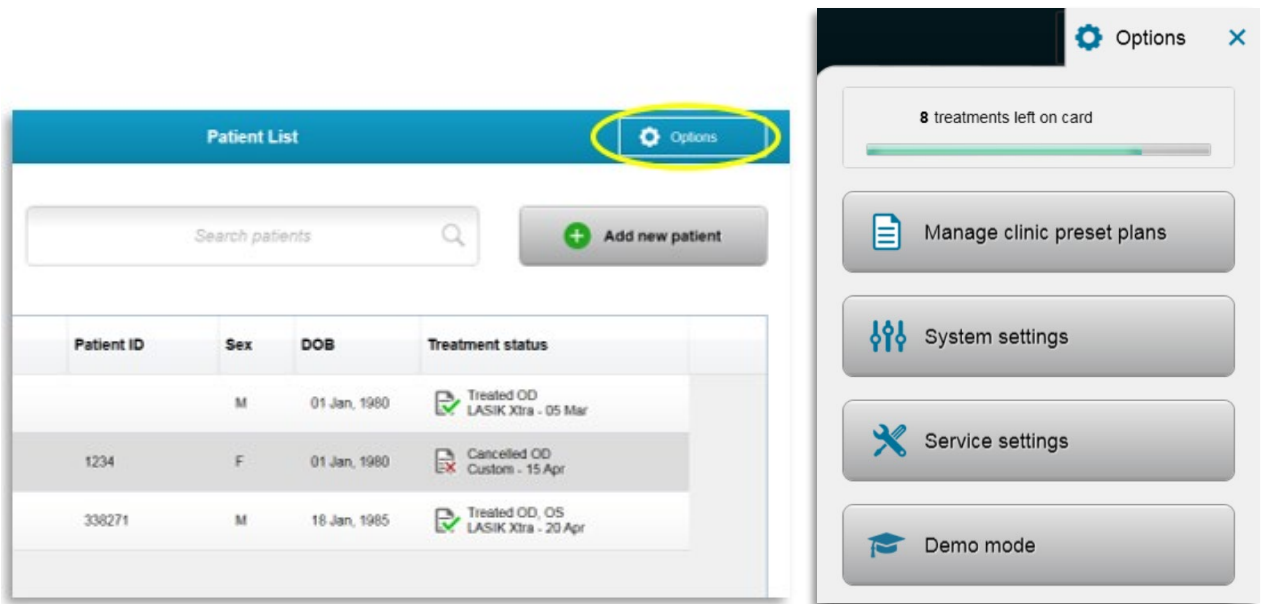

Şekil 3-50. "Seçenekler" (Options) düğmesine basın

3.21.1 Klinik Önceden Ayarlanmış Planları Yönet


- o Herhangi bir Özel ön ayarlı tedavi planını değiştirmek için, "Klinik ön ayar planlarını yönet" (Manage clinic preset plans) seçeneğini seçin.
- o En fazla 4 klinik ön ayar planı kaydedilebilir.

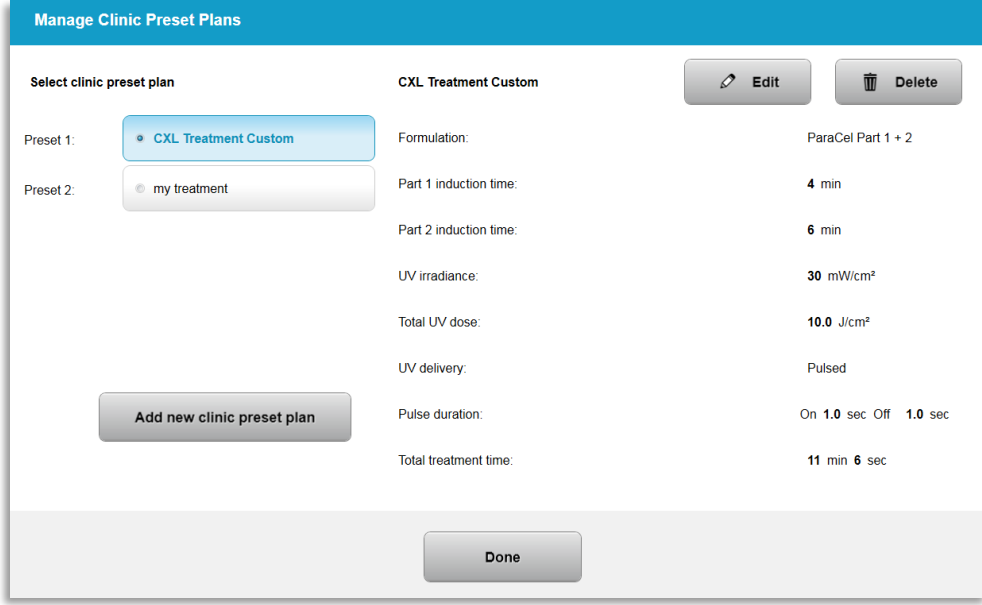

Şekil 3-51. Klinik önceden ayarlanmış planlarını yönet

3.21.2 Sistem Ayarları Menüsü


- Şekil 3-52'de gösterildiği gibi Sistem ayarlarına erişmek için Seçenekler menüsünden "Sistem ayarları" seçeneğini seçin.

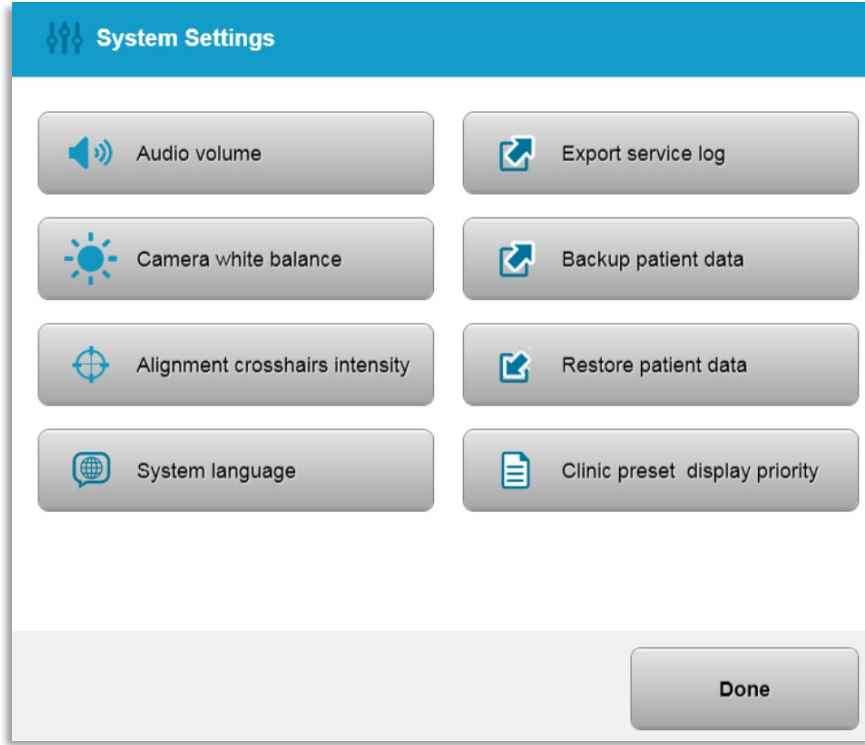

Şekil 3-52. Sistem Ayarları Menüsü

3.21.3 Sistem Ayarları – Sistem Ses Düzeyinin Deđiştirilmesi


- o Ses yüksekliğini deđiştirmek için Sistem Ayarları menüsünden “Ses Yüksekliği” seçeneđini seçin.

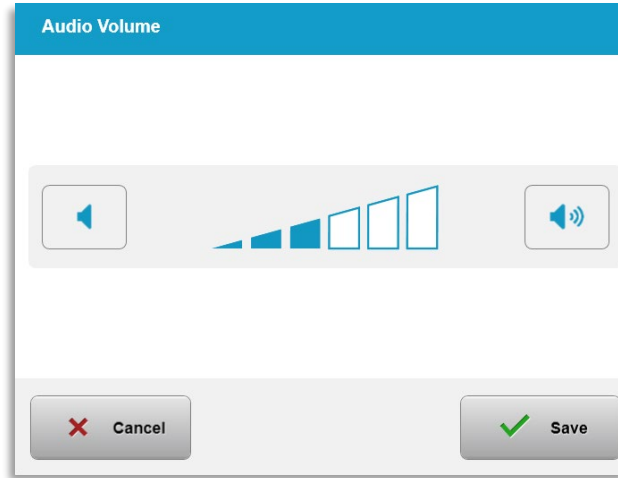

Şekil 3-53. Ses Yüksekliğini Düzenle

3.21.4 Sistem Ayarları – Kamera Beyaz Dengesinin Deđiştirilmesi


- o Konsol içerisindeki ışık koşullarını deđiştirmek için Sistem Ayarları menüsünden “Kamera beyaz dengesi” seçeneđini seçin.
- o Sistem Ayarları menüsüne gitmek için istenen beyaz dengeyi seçerek “Kaydet” seçeneđine tıklayın.
- o **NOT:** Tipik ofis aydınlatması, 5000K altındadır. Sonuç olarak, Sistem varsayılan ayarı, Tungsten 2800K olmaktadır. Farklı bir ışık kaynađının kullanılması halinde beyaz denge koşulunu düzenlemek için kullanışlı olabilir.

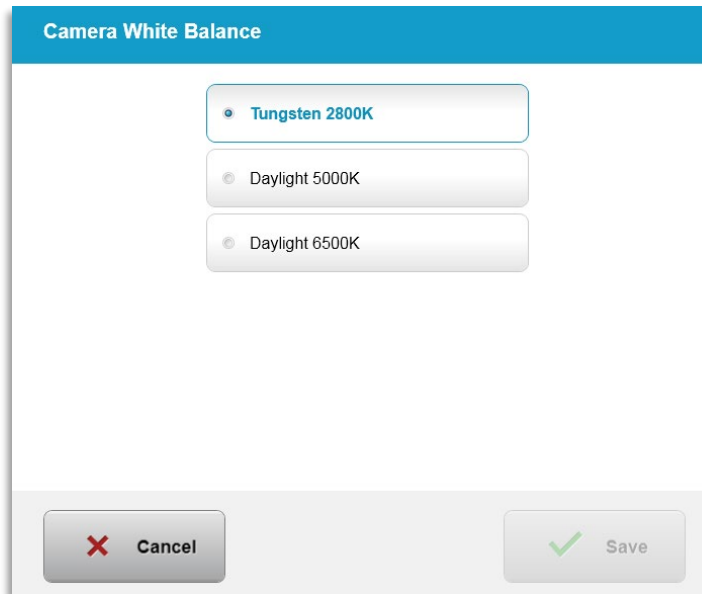

Şekil 3-54. Kamera Beyaz Dengesini Düzenle

3.21.5 Sistem Ayarları – Hizalama Artı İmleçleri Yoğunluğunun Değiştirilmesi

- o Hizalama artı imleçlerinin parlaklığını değiştirmek için Sistem Ayarları menüsünden “Hizalama Artı İmleçleri Yoğunluğu” seçeneğini seçin. Şekil 3-55’te gösterilen ekran görünecektir.
- o Artı imleci parlaklığını ayarlayın ve “Kaydet” (Save) seçeneğini seçin.

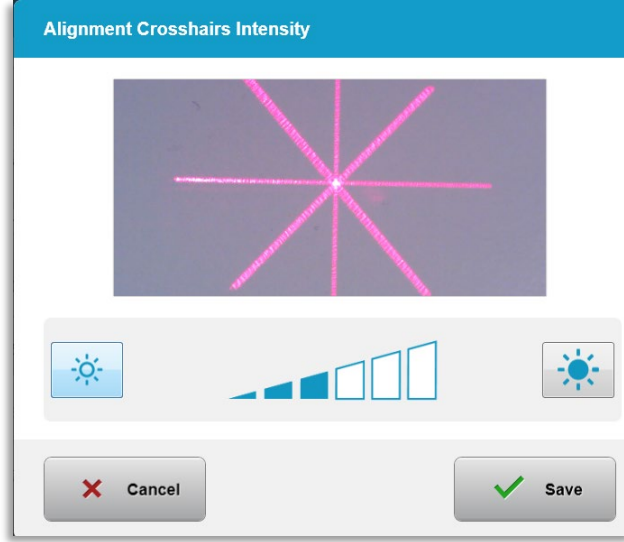

Şekil 3-55. Hizalama Artı İmleçleri Yoğunluğu

3.21.6 Sistem Ayarları – Farklı bir Sistem Dilinin Seçilmesi


- o Grafik Kullanıcı Arayüzü dilini değiştirmek için “Sistem Dili” seçeneğini seçin.
- o Şekil 3-56’da gösterildiği gibi menüden istenen dili seçin.



Şekil 3-56. Sistem Dilini Düzenle


3.21.7 Sistem Ayarları – Hizmet Günlüğünü Dışarı Aktar

- o Sistem Ayarları menüsünden “Hizmet günlüğünü dışarı aktar” (Export service log) seçimi yapın.
- o Şekil 3-57’de gösterildiği gibi USB portuna bir USB diski takmak için ekrandaki talimatı uygulayın.

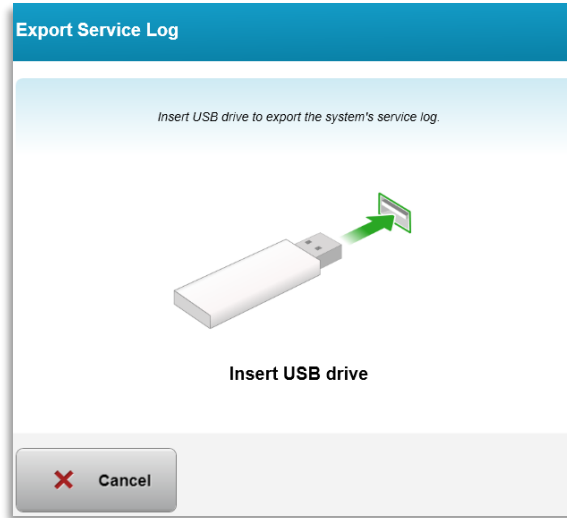

Şekil 3-57. Hizmete Günlüğünü USB’ye Dışarı Aktar

- o Sistem, hizmet günlüğünü otomatik olarak aktarmaya başlar ve Şekil 3-58’de gösterildiği gibi aktarma işleminin ilerleme çubuğunu gösterir.

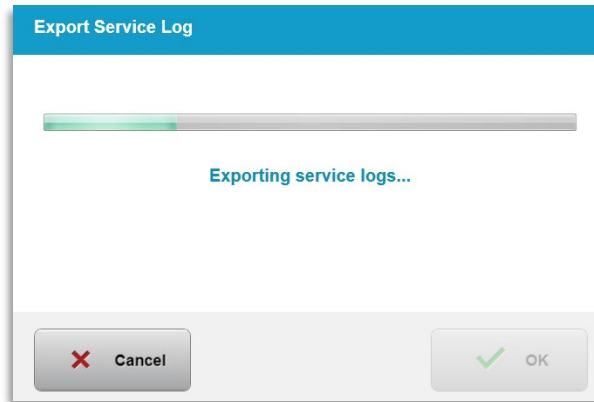

Şekil 3-58. Hizmet Günlüğü Dışarı Aktarılıyor


- o Dışarı aktarma tamamlandığında Sistem Ayarları menüsüne dönmek için “Tamam” (OK) düğmesine basın.

3.21.8 Sistem Ayarları – Hasta Verilerinin Yedeklenmesi ve Saklanması

- o Hasta Verileri bir USB'ye yedeklenebilir ve Seçenekler menüsünden “Hasta Verilerini Yedekle” (Back up Patient Data) seçeneği seçilerek daha sonra Sistem dışında kaydedilebilir.
- o Daha öncesinde bir USB'ye kaydedilmiş Hasta Verileri, Seçenekler menüsünden “Hasta verilerini geri yükle” (Restore patient data) seçeneği seçilerek Sisteme geri yüklenebilir.

3.21.9 Sistem Ayarları – Klinik Önceden Ayarlanmış Ekran Önceliği

- o Tedavi Planı ekranı başlangıçta KXL Varsayılanlarını görüntüler
- o Özel sekmesini KXL Varsayılanları sekmesi yerine birincil tedavi planı sekmesi olarak görüntülemek için, “Klinik ön ayar görüntüleme önceliği” menüsünden “Özel” (Custom) seçeneğini seçin.

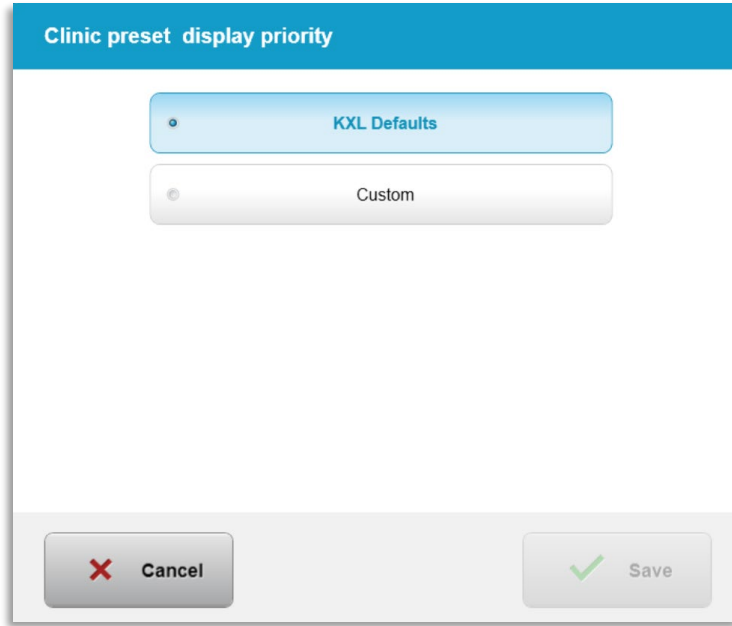

Şekil 3-59. Klinik Önceden Ayarlanmış Ekran Önceliği

3.21.10 Servis Ayarları

- o Servis Ayarları sadece Avedro ve KXL Gelişmiş Ayarlar erişim kartına sahip Servis personeli tarafından kullanılabilir.
- o Seçilmesi halinde kullanıcıdan bir erişim kartı taraması istenir.

3.21.11 Demo Modu

NOT: Tedavi edilen hastalarda kullanılmaz

- o Demo modu, kullanıcıların tedavi kartları gerektirmeden ve UV ışığı kullanmadan KXL Sisteminin kullanımı konusunda eğitim almasını sağlar.
 - “Demo Modu” (Demo Mode) Seçimi Yap


- Sistemi Demo Mod'da kullanmak için "Başlat" (Start) seçimi yapın
- o KXL Sistem ekranları, Sistemde şu anda Şekil 3-60 ve Şekil 3-61'de gösterildiği gibi "Demo Modu" açık olduğunu gösterecektir.
- o Demo Modu seçeneğinden çıkmak için Hasta Listesi ekranından "Demo Modundan Çık" seçeneğini seçin.

The screenshot shows the 'Patient List' interface. At the top, there is a blue header with 'Power off' on the left, 'Patient List' in the center, and 'Options' on the right. Below the header, there is a search bar with the placeholder text 'Search patients' and a magnifying glass icon. To the left of the search bar is a button labeled 'Exit Demo Mode' which is circled in yellow. To the right of the search bar is a button labeled '+ Add new patient'. Below these elements is a table with the following data:

Last	First	Patient ID	Sex	DOB	Treatment status
Anonymous	0001		M	01 Jan, 1980	Treated OD LASIK Xtra - 05 Mar
Anonymous	0005	1234	F	01 Jan, 1980	Cancelled OD Custom - 15 Apr
Thomas	Benjamin	338271	M	18 Jan, 1985	Treated OD, OS LASIK Xtra - 20 Apr

2.0.0.0

Şekil 3-60. Hasta Listesi Demo Modu Gösterir

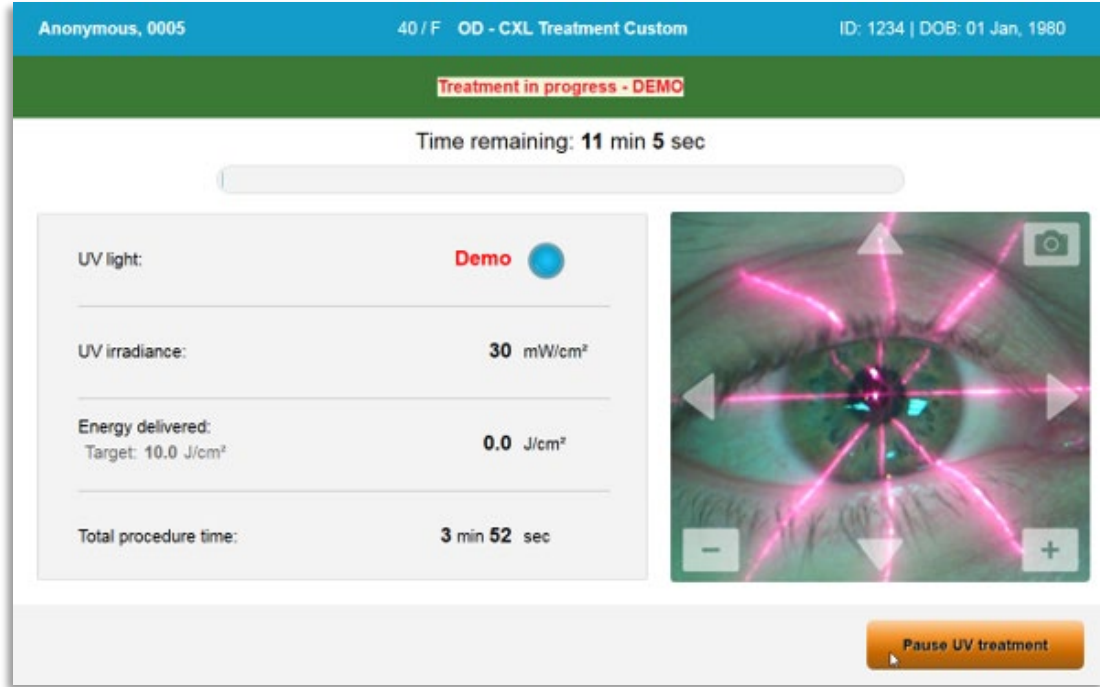

Şekil 3-61. Demo Modu, Ekranın Üstünde gösterilir

4 Bakım / Hizmet

Tanım olarak "bakım", sistemin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için her gün bir operatörün yapması gereken teknik olmayan prosedürleri ifade etmektedir. Bunun aksine, "hizmet" sözcüğü, sadece yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanan görevleri ifade etmektedir.

4.1 Kurulum Politikası

- Her yeni KXL Sistemi müşterisi için, bir Avedro eğitimi almış veya yetkili personel, sistemin tam bir ilk kurulumunu ve başlatılmasını sağlar. İlk kurulumun ardından ve sistem doğru bir şekilde çalıştığında bu Avedro temsilcisi ayrıca KXL Sisteminin temel çalışması hakkında belirlenen operatöre temel eğitim verebilir.
- Sonuç olarak, bu kılavuz, sistemin kurulumu veya yapılması ile ilgili herhangi bir özel talimat içermez. Servis anlaşmanız uyarınca, normal çalışma için belirtilenler dışında herhangi bir ek donanım ayarının bir Avedro yetkili distribütörü tarafından veya onun rehberliğinde yapılması gerekir.

4.2 Müşteri Bakımı

- Genel olarak, KXL Sistemi için müşteri bakımına gerek yoktur. Tüm teknik bakım veya servis, servis sözleşmesi kapsamında nitelikli bir servis temsilcisi tarafından yapılacaktır. Sisteminizle ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki Sorun Giderme bölümüne bakın veya yerel Avedro Temsilcinizi arayın.

4.3 Garanti Bilgileri

- Garanti, satın alma bilgileriyle birlikte ayrıca verilir.

4.4 Servis Sözleşme Bilgileri

- Tüm KXL Sistemlerinde bir servis sözleşmesi mevcuttur. Sözleşme, düzenli olarak programlanmış servis ve saha yükseltmeleri sağlar. Ayrıca gerekli olabilecek programlanmamış servis çağrılarını da sağlar.

4.5 Her bir Hasta için Tek Kullanımlık Malzemeler

- Here bir Hasta için Tek Kullanımlık Ürünler, Avedro veya Avedro yetkili distribütörünüz aracılığıyla sipariş edilebilir. KXL Sisteminizle sadece Avedro ürünlerini veya Avedro onaylı ürünleri kullanın. Avedro,

yetkisiz materyallerin kullanımından kaynaklandığını düşündüğü sistem hasarından veya arızasından sorumlu olmayacaktır.

4.6 Sorun Giderme

- KXL Sistemi, sistem açılışında durumunu otomatik olarak kontrol eder. Durumun doğru olmaması halinde yazılım, operatörün tedavileri başlatmasını engeller.


4.6.1 Kablosuz Uzaktan Kumanda

- KXL Sistemi, değiştirilebilir pillere sahip bir uzaktan kumanda kullanır. Uzaktan kumanda pillerini değiştirmek için, uzaktan kumandanın arkasına ters yönde bastırırken, uzaktan kumandanın önünü düğmeleriyle geriye doğru kaydırın. Bkz. Şekil 4-1.




Şekil 4-1. Pil Bölmesine Eriş

- Pillerin zayıflaması halinde Sistem, uzaktan kumandayla bağlantısını kaybedecek ve kullanıcıyı tekrar denemesi gerektiği konusunda bilgilendirecektir. Uzaktan kumandanın senkronize edilememesi halinde “Uzaktan Kumanda Olmadan Devam Et” (Continue Without Remote) veya “İşlemi İptal Et” (Cancel Treatment) seçeneğini seçin.
- Şekil 4-2, Orijinal Uzaktan Kumandayı kullanan KXL Sistemleri için ekranda kılavuzu gösterir; Şekil 4-3, Güncellenmiş Uzaktan Kumandayı kullanan KXL Sistemleri için ekran kılavuzunu gösterir.

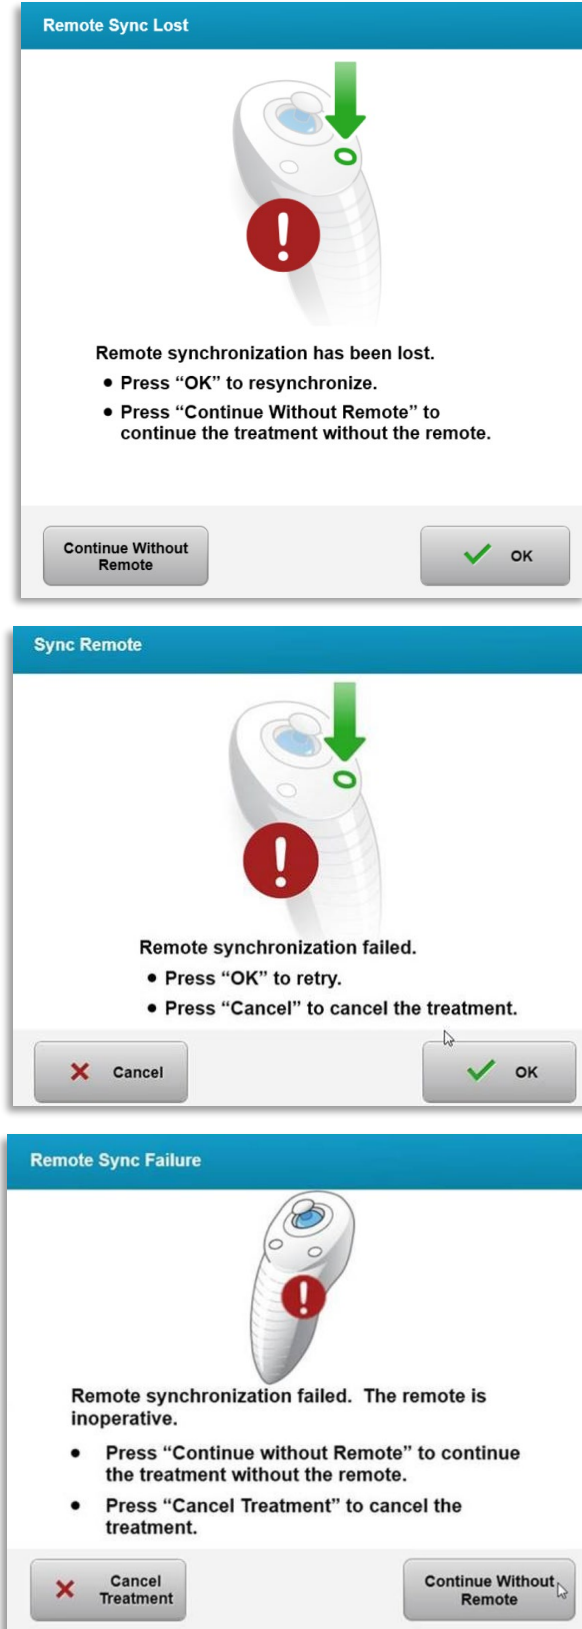

Şekil 4-2. Hizalama Uzaktan Senkronizasyon Kaybı – Orijinal Uzaktan Kumanda

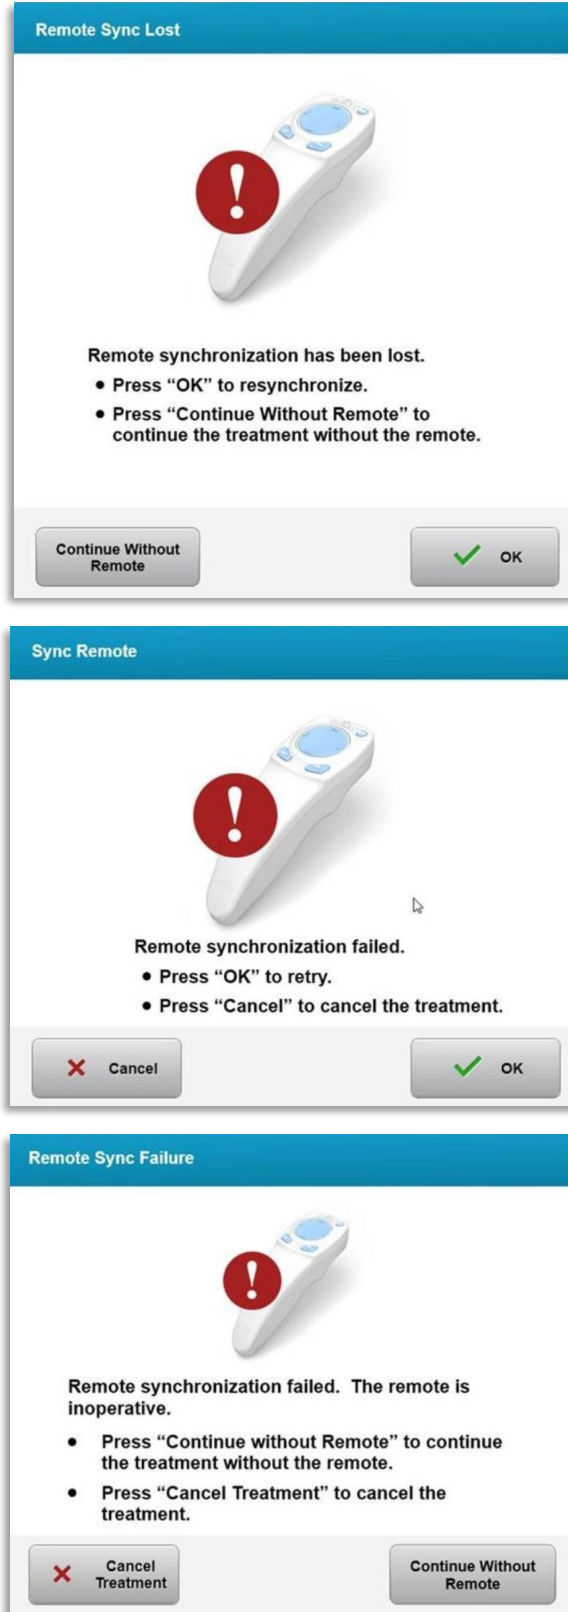

Şekil 4-3. Hizalama Uzaktan Senkronizasyon Kaybı – Güncellenmiş Uzaktan Kumanda

- Orijinal Uzaktan Kumanda
 - Uzaktan kumanda ışığının saniyede iki kez yanıp sönmesi halinde uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerekir.
 - Uzaktan kumanda ışığının saniyede bir kez yanıp sönmesi halinde senkronize edilmemiştir.
 - Uzaktan kumandanın, “Senkronize et” düğmesine basılarak yeniden senkronize edilmemesi halinde pilleri değiştirin.
- Güncellenmiş Uzaktan Kumanda
 - Pil durum ışığının turuncu olması halinde uzaktan kumanda pillerinin kısa süre içinde değiştirilmesi gerekir.
 - Pil durum ışığının turuncu renkte yanıp sönmesi halinde uzaktan kumanda pillerinin hemen değiştirilmesi gerekir – Uzaktan kumandayla bir tedaviyi tamamlamak için yeterli güç yoktur.
- Pillerin değiştirilmesi Sistemin senkronize olmasına izin vermemesi halinde yerel Avedro Servis Temsilcinizle irtibat kurun.

4.7 Dezenfeksiyon Yönlendirmeleri

- KXL Sistemi bileşenleri, operatör tarafından sterilize edilmek üzere tasarlanmamıştır.
- SADECE harici temizlik ve dezenfeksiyon önerilir.
 - Dezenfeksiyon amaçları doğrultusunda, sadece %70 izopropil alkol preparatları veya %10 ağartma solüsyonları kullanın. Yumuşak, lifsiz mendiller kullanın.

4.8 Sistemin Temizlenmesi

- KXL Sistemini temizlemek için yumuşak nemli bir bez kullanın.
- Sistemin dış kısmı, seyreltilmiş ağartıcı, sabunlu su veya izopropil alkol ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bez kullanılarak temizlenebilir.
- Gerekmesi halinde %70 izopropil alkol veya %10 klorlu ağartma solüsyonu da kullanılabilir.
- Sistemi sıvıya DALDIRMAYIN veya sisteme sıvı DÖKMEYİN.



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Herhangi bir temizleme prosedüründen önce sistemi kapatın ve güç kaynağı kablosunu ana prizden çıkarın.



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Demet açıklığının cam penceresinin hiçbir koşulda herhangi bir aşındırıcı temizlik maddesiyle temas etmemesi gerekir.

- Cihazın yüzeylerini temizlerken bu sızıntının cihaza zarar verebileceğinden dolayı temizleme sıvılarının cihazın içine sızmasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandayı temizlemek için izopropil alkolle nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bez kullanın.


4.9 Açıklığın Temizlenmesi

- Tedaviden önce demet açıklığını rutin olarak kontrol edin.
- Açıklığın cam yüzeyinden toz ve partikülleri çıkarmak için kamera lens temizlik bezi veya sıkıştırılmış hava kullanın.

4.10 Eklemlı Kol Ayarlaması


Eklemlı kolun Optik Başlığı sabit, dikey bir konumda tutmaması halinde eklemlı kolu dengelemek için aşağıda özetlenen adımları uygulayın.

- Kolu tam hareket aralığı boyunca yukarı ve aşağı döndürün ve kolu yatay, yani zemine yaklaşık olarak paralel olacak şekilde ayarlayın.

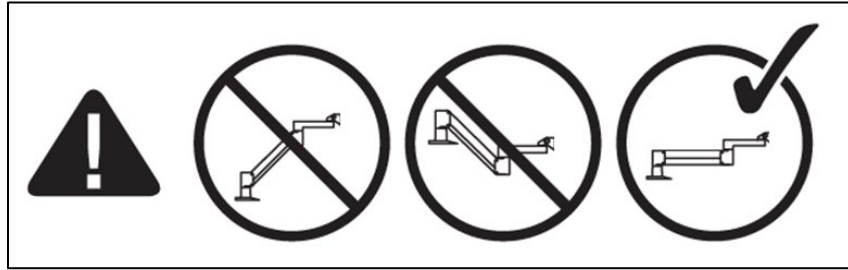


Şekil 4-4. Kolu Zemine Paralel olarak Konumlandırın

- Kolun **aşağı doğru** sürüklenmesi halinde kolu aralığının en üstüne kaldırın ve vidayı en az ½ tur çevirerek **Denge Ayar Vidası A'**'yi gevşetin. 3/32 Alyen Anahtarı Kullanın. Bkz. Şekil 4-5.

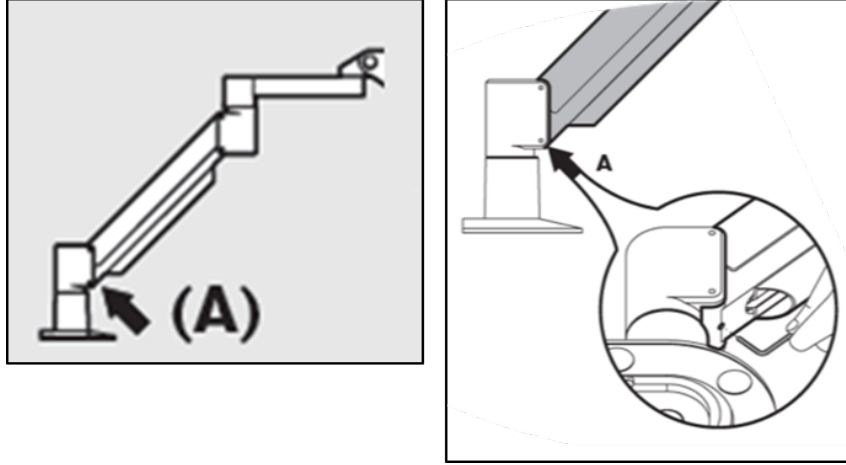

Şekil 4-5. Denge Ayar Vidası A'yı Gevşetin


- Kolu yatay olarak yeniden konumlandırın. Vidayı en az $\frac{1}{2}$ tur çevirerek üst **Denge Ayar Vidası B**'yi gevşetin. 3/32 Alyen Anahtarı Kullanın. Bkz. Şekil 4-6.

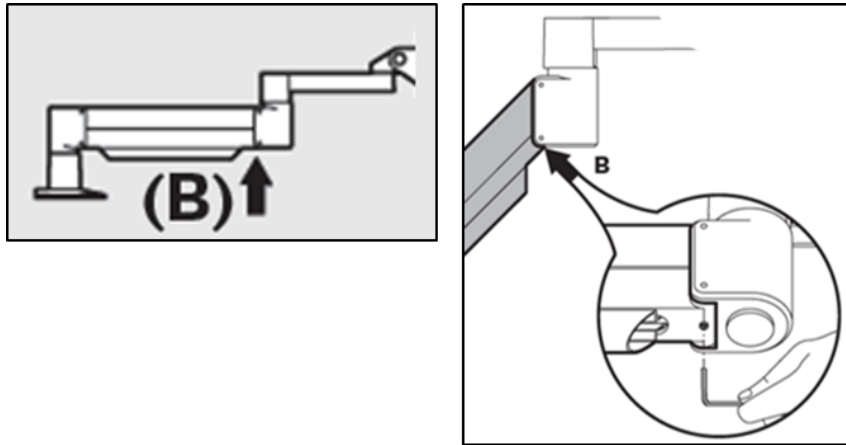

Şekil 4-6. Denge Ayar Vidası B'yı Gevşetin

- Gerektiğinde yükü destekleyerek yatay kol konumunu koruyun.
- **Güç Ayarlama Vidası C** ile kol gerginliğini ayarlayın. 7/32 Alyen Anahtar kullanın ve kol, yukarı doğru yavaşça hareket etmeye başlayana kadar Vida C'yi saat yönünün tersinde döndürün. Ayarladıktan sonra kola hafifçe vurulduğunda hafif bir geri tepme olması gerekir. Bkz. Şekil 4-7.

NOT: 15-20 tur gerekebilir. Kolun düşmeye devam etmesi ve vidanın daha fazla döndürülememesi halinde yerel Avedro hizmet temsilciniz ile irtibat kurun.

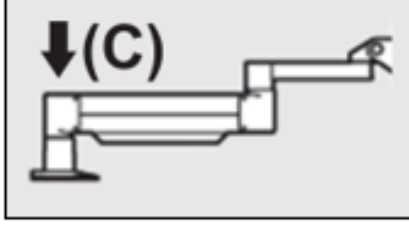


Şekil 4-7. Güç Ayarlama Vidası C ile Kol Gerginliğini ayarlayın

- Saat yönünde Güç Ayarlama Vidası C'ye iki tam dönüş yaptırın.
- Kolun yukarı doğru zorlukla kalkacak kadar sabit olduğundan emin olun.
- Kolu en üst konuma kaldırın ve temas olana kadar **Denge Ayarı Vidası A'yı** sıkıştırın, ardından $\frac{1}{2}$ ila $\frac{3}{4}$ arasında maksimum tam tur sıkıştırın. Bkz. Şekil 4-5.
- Kolu yatay olarak konumlandırın ve **Denge Ayar Vidası B'yı** temas olana kadar sıkın, ardından $\frac{1}{2}$ ila $\frac{3}{4}$ tur sıkın. Bkz. Şekil 4-6.
- Kolu, tam hareket aralığında yukarı ve aşağı döndürün. Yukarı ve aşağı doğru kayma olmadığından emin olun.
- **NOT: Kolun herhangi bir konumdan yukarı doğru kayması halinde yatay konuma geri getirin ve Güç Ayar Vidası C'yi kendiliğinden yukarı kalkmaya kadar saat yönünde $\frac{1}{4}$ tur döndürün.**

4.11 Sistemi Taşınması

- KXL, ofis ortamı içerisinde taşınabilir bir sistem olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir nedenden dolayı KXL Sisteminin taşınması veya gönderilmesi gerekmesi halinde yerel Avedro temsilcinizle irtibat kurun. Sistem paketlenmesinin ve taşınmasının sadece Avedro tarafından eğitim almış ve yetkili personel tarafından yapılması gerekir.
- KXL Sistemi bir odadan diğerine taşımadan önce monitörün yan tarafa taşınması ve KXL Başlığının dirsek arkada çıkıntı yapacak şekilde sepet kulpuna yakın konumlandırılması gerekir. Ardından sistem, kapı kasasından sepet kulpu ile kolaylıkla itilebilir.

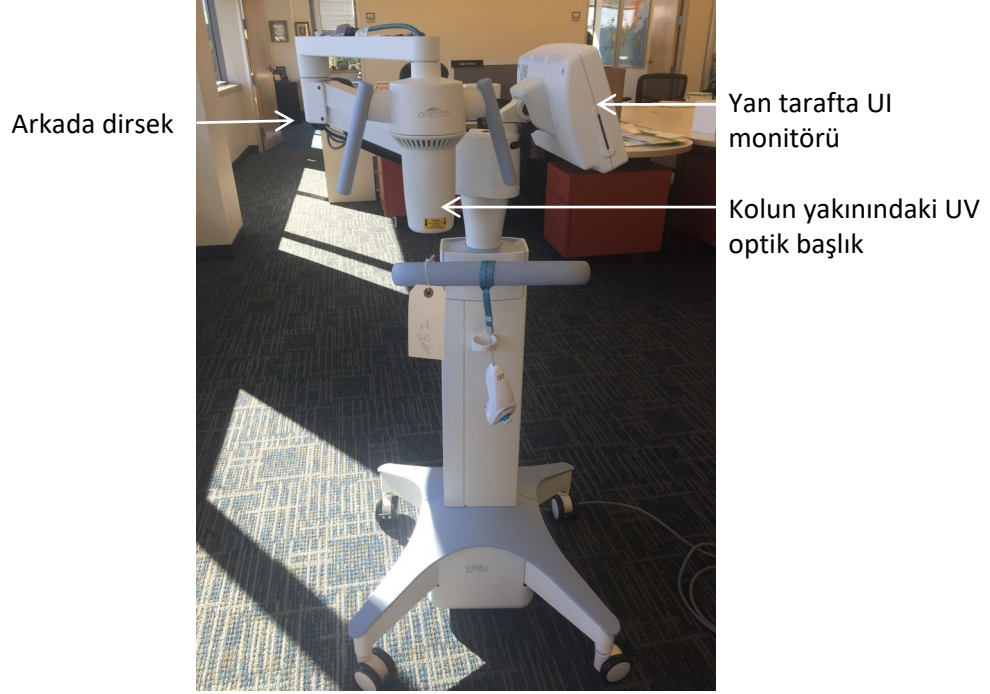

Şekil 4-8. Sistem Yapılandırmasının Taşınması

4.12 Sistemin Saklanması

- Bölüm 7.0 - Teknik Özellikler kısmında listelendiği gibi saklama sıcaklığı ve nem aralığı teknik özelliklerinin tümünü uygulayın.
- Toz ve nemin girmesini önlemek için sistemdeki tüm panelleri kapatın; bu zorunludur.
- Tüm bileşenleri KAPALI duruma getirin ve ana güç anahtarını da kapatın. Güç kablosunu elektrik çıkışından ayırın pilleri kablosuz uzaktan kumandadan çıkarın.
- Yanlış hizalama veya hasara neden olabileceğinden dolayı sistemin herhangi bir parçasını sökmeyin.

4.13 Yazılım

- Yazılımın bozulması ve doğru şekilde çalışmaması halinde yerel Avedro hizmet temsilcinizi arayın. Yazılım güncellemeleri sadece Avedro hizmet temsilcileri tarafından gerçekleştirilecektir.

4.14 Atık Ürünlerin İmhası ile İlişkili Riskler

- Atık ürünleri imha ederken tüm geçerli yerel düzenlemeleri uygulayın.

4.15 Görünür Bir Kontrol Gerçekleştirilmesi

- Cihazın tüm bileşenlerini her bir tedaviden önce hasar veya arıza açısından kontrol edin.

5 Ekipman Sınıflandırması

EN60601-1 Elektrikli Tıbbi Cihaz Standardına Göre

- Elektrik çarpmasına karşı koruma
 - Sınıf 1 (harici elektrikli güç kaynağı)
- Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi
 - Sınıflandırılmamış, uygulanan parça ile birlikte verilmeyen ekipman
 - Sistem girişinin korunması: IP20 (su girişine karşı koruma yok)
 - Güncellenmiş uzaktan kumanda giriş koruması: IP53
- Sterilizasyon veya dezenfeksiyon yöntemi
 - Dezenfekte edilebilir cihaz
 - Anestetik karışım gibi alev alabilen bir madde varlığında kullanım için koruma derecesi
 - Koruma yok
 - Kullanım koşulları
 - Sürekli hizmet

FCC Kısım 15, EN55011 ve EN60601-1-2 uyarınca

- Sınıf B

EN60825-1 Lazer ürünlerinin güvenliği

- Hizalama lazerleri, Sınıf 1 Lazer Ürünüdür

EN62471 Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyoloji güvenliği

- IEC 62471:2006 Risk Grubu 2
- EN 62471:2008 Risk Grubu 3

93/42/EEC Yönergesinin Ek II.3 uyarınca


- Sınıf IIa

EMC Gereksinimleri

KXL Sistemi, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile ilgili özel önlemler gerektirir. Kurulum ve kullanımın bu kılavuzda verilen EMC bilgilerine göre gerçekleştirilmesi gerekir. Taşınabilir ve mobil RF bağlantı ekipmanı, KXL Sistemi etkileyebilir.

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik emisyonlar		
KXL sistemi, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. KXL Sisteminin müşterisi veya kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.		
Emisyonlar testi	Uyum	Elektromanyetik ortam – kılavuz
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	KXL Sistemi, sadece dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Bu yüzden, RF emisyonları çok düşüktür ve yakın elektronik ekipmanda herhangi bir parazite neden olmayabilir.
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf B	KXL Sistemi, konutlar ve konut amaçlı kullanılan binaları besleyen kamuya açık düşük voltajlı güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı olanlar da dahil olmak üzere tüm kuruluşlarda kullanıma uygundur. Uyarı: Bu ekipmanın emisyon özellikleri endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanılmasını uygun kılar (CISPR 11 sınıf A). Bu ekipman ikamet ortamında kullanılırsa (normalde bunun için CISPR 11 sınıf B gerekir) radyo frekansı iletişim hizmetlerine karşı yeterli koruma sunmayabilir. Kullanıcının ekipmanın konumunu veya yönünü değiştirmek gibi hafifletici tedbirler alması gerekebilir.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları/titre emisyonları IEC 61000-3-3	Uyumludur	

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik bağışıklık			
KXL sistemi, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. KXL Sisteminin müşterisi veya kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
Bağışıklık testi	IEC 60601 test düzeyi	Uyum düzeyi	Elektromanyetik ortam - kılavuz
Elektrostatik boşalma (ESD) IEC 61000-4-2	+/-8 kV kontak +/-15 kV hava	+/-8 kV kontak +/-15 kV hava	Zeminlerin ahşap, beton veya seramik karo olması gerekir. Zeminler sentetik malzeme ile kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır.
Elektrik hızlı geçiş/patlama IEC 61000-4-4	güç kaynağı hatları için +/-2 kV giriş/çıkış hatları için +/-1 kV	güç kaynağı hatları için +/-2 kV Geçerli değil Giriş/Çıkış Hatları	Şebeke elektriği, tipik ticari ortam veya hastane ortamı kalitesinde olmalıdır.
Aşırı Akım IEC 61000-4-5	+/- 1 kV hattan (hatlardan) hatta (hatlara) +/-2 kV hattan (hatlardan) topraklamaya	+/- 1 kV hattan (hatlardan) hatta (hatlara) +/-2 kV hattan (hatlardan) topraklamaya	Şebeke elektriği, tipik ticari ortam veya hastane ortamı kalitesinde olmalıdır.
Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşüşleri, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	%0 UT 0,5 döngü için (UT'de %100 azalma) %0 UT 1 döngü için (UT'de %100 azalma) %70 UT 25/30 döngü için (UT'de %30 azalma) %0 UT 5 saniye için (UT'de %100 azalma)	%0 UT 0,5 döngü için (UT'de %100 azalma) %0 UT 1 döngü için (UT'de %100 azalma) %70 UT 25/30 döngü için (UT'de %30 azalma) %0 UT 5 saniye için (UT'de %100 azalma)	Şebeke güç kalitesinin tipik bir ticari veya hastane ortamındaki gibi olması gerekir. KXL Sistemi kullanıcısının ana şebeke kesintileri sırasında sürekli çalışmaya ihtiyaç duyması halinde KXL Sistemine kesintisiz bir güç kaynağı veya bir pilden güç sağlanması önerilir.
Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Güç frekansı manyetik alanlarının tipik bir ticari veya hastane ortamındaki tipik bir konumdaki ile aynı düzeylerde olması gerekir.
NOT: UT, test düzeyi uygulamasından önceki AC şebeke voltajıdır.			

Kılavuz ve üretici beyanı — elektromanyetik bağışıklık			
APD sistemi, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. KXL Sisteminin müşterisi veya kullanıcısı cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.			
Bağışıklık testi	IEC 60601 test düzeyi	Uyum düzeyi	Elektromanyetik ortam — kılavuz
İletilen RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz arasında	3 Vrms	Taşınabilir ve mobil RF bağlantı ekipmanının kablolar da dahil olmak üzere KXL Sisteminin herhangi bir parçasına, verici frekansı için geçerli denklemden hesaplanan önerilen ayırma mesafesinden daha yakın kullanılmaması gerekir. Önerilen ayırma mesafesi $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz ila 800 MHz arasında $d = 1,2\sqrt{P}$
Işınan RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz arasında	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 2,3\sqrt{P}$ 80 MHz ila 2,7 GHz arasında P, verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeridir ve d, metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir. Bir elektromanyetik bölge araştırmasıyla ^a belirlendiği gibi sabit RF vericilerinden alınan alan güçlerinin her bir frekans aralığındaki uyum düzeyinden düşük olması gerekir. ^b Aşağıdaki simgeyi taşıyan ekipmanların yakınında parazit oluşabilir:
RF kablosuz bağlantı ekipmanlarından yakınlık alanları (IEC 61000-4-3:2006 A1:2007 A2:2010)	15 özel frekans. Bağışıklık düzeyi 9-28 V/m	15 özel frekans. Bağışıklık düzeyi 9-28 V/m	
NOT 1 80 MHz'de ve 800 MHz'de üst frekans aralığı geçerlidir.			
NOT 2 Bu kılavuz ilkeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik iletim yapılar, nesnelere ve kişilerden kaynaklanan soğurma ve yansımadan etkilenir.			
<p>a Telsiz (hücreli/kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerin alan güçleri teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericileri nedeniyle elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik alan incelemesinin göz önünde bulundurulması gerekir. KXL Sisteminin kullanıldığı konumdaki ölçülen alan gücünün yukarıdaki geçerli RF uyumluluk düzeyini aşması halinde KXL Sisteminin normal çalışmayı doğrulamak için gözlenmesi gerekir. Anormal performansın gözlenmesi halinde KXL Sistemini yeniden konumlandırma veya yeniden yerleştirme gibi ilave ölçümler gerekli olabilir.</p> <p>b 150 kHz ila 80 MHz arasındaki frekans aralığının üstünde alan güçlerinin 3 V/m'den az olması gerekir.</p>			

Taşınabilir ve Mobil RF Bağlantı Ekipmanı ve KXL Sistemi arasında Önerilen Ayırma Mesafeleri.

KXL Sistemi, ışınan RF bozulmalarının kontrol edildiği elektromanyetik bir ortamda kullanım için tasarlanmıştır. KXL Sisteminin müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF bağlantı ekipmanı (vericiler) ve KXL Sistemi arasında, bağlantı ekipmanının azami çıkış gücüne göre aşağıda önerilen asgari mesafeleri koruyarak elektromanyetik parazitin önlenmesine yardımcı olabilir.

Vericinin sınıflandırılmış maksimum çıkış gücü (W)	Verici frekansına göre ayırma mesafesi m		
	150 kHz ila 80 MHz arasında $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz ila 800 MHz arasında $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz ila 2,7 GHz arasında $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Nominal azami çıkış gücü yukarıda belirtilmeyen vericilerin metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi d, P'nin verici üreticisine göre vericinin watt (W) cinsinden azami gücü olduğu verici frekansı denklemleriyle hesaplanabilir.

NOT 1 80 MHz'de ve 800 MHz'de üst frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

NOT 2 Bu kılavuz ilkeler tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik iletim yapılar, nesnelere ve kişilerden kaynaklanan soğurma ve yansımadan etkilenir.



KXL Sistemi, 13,56 MHz frekansında ileten ve alan bir RFID işlevi içerir. Bu ekipmanın CISPR Emisyon gereksinimlerine uygun olması durumunda bile diğer ekipmanla işlevsellik arasında parazit olabilir.

KXL Sistemi, aşağıdaki RF vericilerini içerir:
RFID Okuyucu
<ul style="list-style-type: none"> • 13,56 MHz Okuyucu/Yazıcı • İntegral Anten: Maksimum 4 inçlik Okuma Aralığı • Maksimum çıkış gücü 200 mW'dir • Uygundur: ISO18000-3, ISO15693

Yukarıdaki ekipman tarafından üretilen en yüksek emisyonlar aşağıda listelenmiştir:

Temel	Frekans (MHz)	30 m'de Düzey (dB μ V/m)	30 m'de Sınır (dB μ V/m)	30 m'de Sınır (μ V/m)	Marjin (dB)
Paragraf 15.225(a)	13,56 (pik)	29,8	84	15.848	-54,2

Diğer	Frekans (MHz)	Düzey (dB μ V/m)	Sınır (dB μ V/m)	Marjin (dB)
Harmonik	27,12 (pik)	-5,2	29,5	-34,7
Parazit	200,6 (pik)	34,5	40,0	-5,5
İletilen	0,199 (ortalama)	38,8	54,6	-15,8

Kablosuz Uzaktan Kumanda

- FCC ID SXJ87027-TX
- Frekans Aralığı 2405 MHz ila 2475 MHz











- 47 CFR Bölüm 15'e Uyumlu Emisyon

Kablosuz Uzaktan Kumanda

- FCC ID 2AVGK-KXLTX
- Frekans Aralığı 2402 MHz ila 2480 MHz
- CFR Bölüm 15'e Uyumlu Emisyonlar

6 Sembol Kütüphanesi

Metin Sembolü	Sembol Görseli	Tanım
1. Alev alabilen anestetiklerin varlığında AP sembolü yok		Tehlike, Patlama Riski Kullanılmaz
2. AC Sembolü		Alternatif akım
3. Bir kitap içindeki "i"		Dikkat: EKTEKİ BELGELERE bakınız
4. Daire içindeki topraklama sembolü		Korumalı topraklama (toprak hattı)
5. Giriş Koruması Sembolü	<p>IP20 <i>(orijinal uzaktan kumanda)</i></p> <p>IP53 <i>(güncellenmiş uzaktan kumanda)</i></p>	Cihaz yukarı doğru tutulduğunda veya hafifçe sıçradığında toza karşı korumalı ve su girişine karşı korumalı
6. Güç düğmesi		Bekleme
7. Güç Anahtarı		AÇIK
8. Güç Anahtarı	o	KAPALI
9. CE İşareti		Uygunluk işareti
10. Üretici		Üreticinin adı ve adresi
11. ! Üçgen içinde		İkaz operatör kılavuzunda özel uyarı
12. Net Ağırlık (kg) Brüt Ağırlık (kg)	<p>NW</p> <p>GW</p>	Ağırlık

Metin Sembolü	Sembol Görseli	Tanım
13. Yağmur damlaları ile şemsiye		Kuru Yerde Muhafaza Edin: Nemden koruyarak saklayın (yağmur damlalarının olduğu veya olmadığı sembol)
14. Kırık cam		İçindekiler kırılır, dikkatli taşıyın
15. İki adet yukarı ok		Oklar yukarı bakacak şekilde kartonu tutun
16. Kutudaki su damlası		Nem sınırı (sembolün altındaki yüzdeler, kabul edilebilir nem aralığıdır)
17. Çalışma sıcaklığı sınırları		Çalışma sıcaklığı sınırları
18. Saklama sıcaklığı sınırları		Saklama sıcaklığı sınırları
19. Daire içinde üzeri çizili MR		MR Güvensiz - Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ekipmanından uzak tutun.
20. Saklama basıncı sınırları		Saklama atmosferik basıncı sınırları
21. Çalışma Basıncı sınırları		Çalıştırma Atmosfer basıncı sınırları
22. Yayılan sinyal		Cihaz aracılığıyla iletilen RF

7 Teknik Özellikler

Teknik Özellik	Açıklama
Elektrikli	Hat voltajları 100 - 240 volt AC Akım 2A - 1A Sinyal Fazı RMS, 50/60 Hz Orijinal Uzaktan Kumanda 2x AAA piller Güncellenmiş Uzaktan Kumanda 2x AA piller
Kabloların ve Aksesuarların Listesi	Kablosuz uzaktan Kumanda Hastane sınıfı AC güç kablosu (Kilitlenebilir/Ayrılabilir)
Enerji İletimi	UV Radyasyonu 3 - 45 mW/cm ² +/- %10 365 nm
UVA LED Işık Kaynağı	UV Radyasyonu 365 nm
Harici Arayüzler	USB 2,0
Fiziksel Boyutlar	60 x 60 x 150 cm'den daha geniş değil (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Ağırlık (sandıklı sistem)	NW 48 Kg GW 120 Kg
Uzaktan Kumanda Pil Ömrü (normal çalışma koşulları)	18 saat
Uzaktan ve Dongle FCC ID ve Çalıştırma Frekansları	FCC ID: SXJ87027-TX (orijinal uzaktan kumanda) FCC ID: 2AVGK-KXLTX (güncellenmiş uzaktan kumanda) 2,405-2,475 GHz.
Ortama Bağlı Çalışma Koşulları	Sistem, aşağıdaki atmosfer koşulları altında çalışır (yoğuşma yok).
Ortam sıcaklığı	+15 ila +30 °C arasında
Göreceli nem	%20 ila %80 arasında, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı	810 ila 1050 mbar arasında
Taşıma ve Saklama Koşulları	Alet, hasar veya performans kaybı olmaksızın aşağıdaki taşıma ve saklama koşullarına dayanır.
Ortam sıcaklığı	-15 ila +60 °C arasında
Göreceli nem	%10 ila %80 arasında, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı	750 ila 1060 mbar arasında